



Οδηγίες χρήσης

RadiForce® RX670

Έγχρωμη οθόνη LCD

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Οδηγίες χρήσης και το Εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν από τη χρήση.

- Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης για τις ρυθμίσεις και τις οδηγίες προσαρμογής της οθόνης.
- Οι πιο πρόσφατα επικαιροποιημένες πληροφορίες όσον αφορά το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών χρήσης, διατίθενται στην ιστοσελίδα μας.

www.eizoglobal.com

ΣΥΜΒΟΛΑ

Το παρόν εγχειρίδιο και προϊόν χρησιμοποιούν τα παρακάτω σύμβολα. Καταδεικνύουν κρίσιμες πληροφορίες. Διαβάστε τες με προσοχή.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες που αφορούν την επισήμανση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός και να δημιουργηθεί θανάσιμος κίνδυνος.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες που αφορούν στην επισήμανση ΠΡΟΣΟΧΗ, μπορεί να προκληθεί μικροτραυματισμός ή/και υλικές ζημιές ή/και ζημιά στο προϊόν.
	Δηλώνει μια προειδοποίηση ή ένδειξη προσοχής. Για παράδειγμα, το  υποδεικνύει κίνδυνο «ηλεκτροπληξίας».
	Δηλώνει μια ενέργεια που απαγορεύεται. Για παράδειγμα, το  σημαίνει «Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση».

Το προϊόν αυτό έχει προσαρμοστεί ειδικά για χρήση στην περιοχή όπου αποστέλλεται αρχικά.

Αν χρησιμοποιηθεί εκτός αυτής της περιοχής, ενδέχεται να μην αποδίδει όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο -ηλεκτρονικό, μηχανικό ή με άλλο τρόπο- οποιουδήποτε μέρους αυτού του εγχειριδίου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της EIZO Corporation.

Η EIZO Corporation δεν έχει ουδεμία υποχρέωση διατήρησης του απορρήτου οποιουδήποτε υλικού ή οποιασδήποτε πληροφορίας έχει υποβληθεί, εκτός εάν έχουν υπάρξει προηγούμενες συμφωνίες περί λήψης τέτοιων πληροφοριών από την EIZO Corporation. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι το παρόν εγχειρίδιο παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι οι προδιαγραφές του προϊόντος EIZO υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σημαντικό

Το προϊόν αυτό έχει προσαρμοστεί ειδικά για χρήση στην περιοχή όπου αποστέλλεται αρχικά. Αν χρησιμοποιηθεί εκτός αυτής της περιοχής, ενδέχεται να μην αποδίδει όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές του.

Για την προσωπική σας ασφάλεια και τη σωστή συντήρηση της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ» και τα σήματα υπόδειξης ασφαλείας πάνω στην οθόνη.

Θέση του σήματος υπόδειξης ασφαλείας

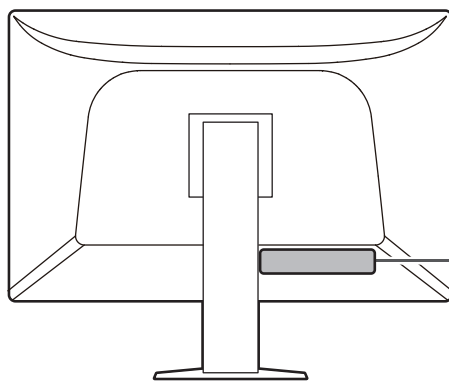


WARNING
 RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.
AVERTISSEMENT
 RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.
WARNUNG
 GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.
 警告
 触电危険、请勿打开后盖。
 警告
 感電の恐れあり、カバーをあけないでください。
 The equipment must be connected to a grounded main outlet.
 L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
 Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
 Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
 设备必须连接到接地的电源插座。
 電源コードのアースは必ず接地してください。

Σύμβολα πάνω στη μονάδα


Σύμβολο	Το σύμβολο αυτό δηλώνει
	Διακόπτης τροφοδοσίας: Πατήστε τον για να απενεργοποιήσετε την κεντρική τροφοδοσία της οθόνης.
	Διακόπτης τροφοδοσίας: Πατήστε τον για να ενεργοποιήσετε την κεντρική τροφοδοσία της οθόνης.
	Κουμπί τροφοδοσίας: Πατήστε το για να ανάψετε ή να σβήσετε την οθόνη.
	Εναλλασσόμενο ρεύμα
	Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Σήμανση ΑΗΗΕ: Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά, τα υλικά επιδέχονται ανακύκλωση.
	Σήμανση CE: Σήμα συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας ή/και του Κανονισμού του Συμβουλίου.
	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) περιορίζει την πώληση της παρούσας συσκευής από αδειοδοτημένο γιατρό ή κατ' εντολήν αδειοδοτημένου γιατρού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σύμβολο	Το σύμβολο αυτό δηλώνει
	Ιατρικό προϊόν στην ΕΕ
EU Importer	Εισαγωγέας στην ΕΕ
	Σήμα που υποδεικνύει συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου
	Υπεύθυνο πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελβετία
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Αν από τη μονάδα αρχίζει να βγαίνει καπνός ή αν η μονάδα μυρίζει σαν να καίγεται ή κάνει παράξενους θορύβους, αποσυνδέστε αμέσως όλες τις συνδέσεις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της EIZO για βοήθεια. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα που δυσλειτουργεί, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε ούτε να τροποποιήσετε τη μονάδα. Το άνοιγμα του περιβλήματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα από εξαρτήματα υψηλής τάσης ή υψηλής θερμοκρασίας. Η τροποποίηση της μονάδας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε εσείς οι ίδιοι το προϊόν, γιατί ενδεχόμενο άνοιγμα ή αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κρατήστε ξένα αντικείμενα ή υγρά μακριά από τη μονάδα. Η πτώση μεταλλικών μερών, εύφλεκτων υλικών ή υγρών κατά λάθος μέσα στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. Αν κάποιο αντικείμενο ή υγρό πέσει ή χυθεί στο εσωτερικό του περιβλήματος, αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από το ρεύμα. Αναθέστε τον έλεγχο της μονάδας σε εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης προτού να την χρησιμοποιήσετε ξανά. 
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Τοποθετήστε τη μονάδα σε στιβαρή και σταθερή βάση. Αν η μονάδα τοποθετηθεί σε ακατάλληλη επιφάνεια, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Αν η μονάδα πέσει, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της EIZO. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μια μονάδα που έχει υποστεί ζημιά. Η χρήση μονάδας που έχει υποστεί ζημιά ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς στον εξοπλισμό. • Μην την τοποθετήσετε σε εξωτερικούς χώρους. • Μην την τοποθετήσετε σε κανένα μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροσκάφος, τρένο, αυτοκίνητο κλπ). • Μην την τοποθετήσετε σε περιβάλλον με σκόνη ή υγρασία. • Μην την τοποθετήσετε σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος να πιτσιλιστεί η οθόνη (μπάνιο, κουζίνα, κλπ). • Μην την τοποθετήσετε σε χώρους με ατμό που έρχεται σε άμεση επαφή με την οθόνη. • Μην την τοποθετήσετε κοντά σε συσκευές παραγωγής θερμότητας ή υγραντήρες. • Μην την τοποθετήσετε σε χώρους όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένη στο φως του ήλιου. • Μην την τοποθετήσετε σε περιβάλλον όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο. • Μην την τοποθετήσετε σε χώρους με διαβρωτικά αέρια (όπως διοξείδιο του θείου, υδρόθειο, διοξείδιο του αζώτου, χλώριο, αμμωνία και όζον). • Μην την τοποθετήσετε σε χώρους με σκόνη, συστατικά που επιταχύνουν τη διάβρωση στην ατμόσφαιρα (όπως χλωριούχο νάτριο και θείο), αγωγίμα μέταλλα και ούτω καθεξής. 
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας μακριά από βρέφη και παιδιά. Οι πλαστικές σακούλες συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε τη μονάδα σε τυπική πρίζα ρεύματος στη χώρα σας. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται η ονομαστική τάση του καλωδίου ρεύματος. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Τροφοδοσία: 100-240 Vac 50/60 Hz
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, κρατήστε σταθερά το βύσμα και τραβήξτε. Ενδεχόμενο τράβηγμα του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο και πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.  OK  
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Χρησιμοποιείτε τη σωστή τάση.**

- Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με συγκεκριμένη τάση. Η σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτήν που καθορίζονται στις παρούσες «Οδηγίες χρήσης» ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.
Τροφοδοσία: 100-240 Vac 50/60 Hz
- Μην υπερφορτώνετε το κύκλωμα τροφοδοσίας, γιατί ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Χειρίζεστε προσεκτικά το καλώδιο ρεύματος.**

Μην αφήνετε πάνω του βαριά αντικείμενα, μην τραβάτε και μην δένετε το καλώδιο ρεύματος. Η χρήση καλωδίου ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Ο χειριστής δεν πρέπει να αγγίζει τον ασθενή την ώρα που αγγίζει το προϊόν.**

Το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να το αγγίζουν οι ασθενείς.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Μην αγγίζετε ποτέ το βύσμα και το καλώδιο ρεύματος αν αρχίσει να βγάζει σπινθήρες.**

Τυχόν επαφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Αν συνδέσετε βάση με βραχίονα, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης της βάσης και εγκαταστήστε τη μονάδα με ασφάλεια.**

Διαφορετικά, η μονάδα μπορεί να αποσυνδεθεί και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και ζημιά στον εξοπλισμό.

Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι τα γραφεία, οι τοίχοι ή οποιοσδήποτε άλλες επιφάνειες εγκατάστασης διαθέτουν επαρκή μηχανική αντοχή.

Αν η μονάδα πέσει, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία και συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της EIZO. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μια μονάδα που έχει υποστεί ζημιά. Η χρήση μονάδας που έχει υποστεί ζημιά ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Όταν επαναπροσαρμόσετε τη ρυθμιζόμενη βάση, χρησιμοποιήστε τις ίδιες βίδες και σφίξτε τις καλά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Μην αγγίζετε με γυμνά χέρια μια οθόνη LCD που έχει υποστεί ζημιά.**

Αν κάποιο σημείο της επιδερμίδας σας έλθει σε άμεση επαφή με την οθόνη, πλυθείτε καλά.

Αν πέσει υγρός κρύσταλλος στα μάτια σας ή στο στόμα σας, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και πηγαίnete αμέσως στον γιατρό. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τοξική αντίδραση.





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για εγκατάσταση σε ψηλά σημεία, ζητήστε τη βοήθεια ενός επαγγελματία.

Κατά την εγκατάσταση της οθόνης σε κάποιο ψηλό σημείο, υπάρχει κίνδυνος πτώσης του προϊόντος ή εξαρτημάτων του και πρόκλησης τραυματισμού. Ζητήστε βοήθεια από εμάς ή από έναν επαγγελματία που ειδικεύεται στις κατασκευαστικές εργασίες κατά την εγκατάσταση της οθόνης, μεταξύ άλλων για την επιθεώρηση του προϊόντος για τυχόν ζημιές ή παραμορφώσεις τόσο πριν όσο και μετά την εγκατάσταση της οθόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός του οπίσθιου φωτισμού ή του φωτισμού εργασίας.
Μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει δυσφορία στα μάτια και προβλήματα όρασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στον βραχίονα του φωτός εργασίας.
Η κάμψη ή η συστολή του βραχίονα με μεγάλη δύναμη μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή δυσλειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγξτε τη λειτουργική κατάσταση της μονάδας προτού τη χρησιμοποιήσετε.
Προχωρήστε στη χρήση της αφού βεβαιωθείτε ότι προβάλλεται εικόνα χωρίς προβλήματα.
Κατά τη χρήση πολλαπλών μονάδων πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες προβάλλονται όπως πρέπει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στερεώστε γερά τα καλώδια που διαθέτουν διάταξη συγκράτησης.
Αν δεν τα στερεώσετε καλά, ενδέχεται να αποσυνδεθούν και, κατά συνέπεια, να διακοπεί η απεικόνιση και οι εργασίες σας γενικώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ




Αποσυνδέστε τα καλώδια και αφαιρέστε τα εξαρτήματα πριν από τη μετακίνηση της μονάδας.
Διαφορετικά, τα καλώδια ή τα εξαρτήματα μπορεί να αποσυνδεθούν κατά τη μετακίνηση, προκαλώντας τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μεταφέρετε ή τοποθετείτε τη μονάδα ακολουθώντας τις σωστές μεθόδους.

- Όταν μετακινείτε το προϊόν, κρατάτε σταθερά το κάτω μέρος της οθόνης.
- Οι οθόνες μεγέθους 30 ιντσών και άνω είναι βαριές. Φροντίστε να αναλαμβάνουν τουλάχιστον δύο άτομα την αποσυσκευασία ή/και τη μεταφορά της οθόνης.
- Αν το μοντέλο της συσκευής σας διαθέτει λαβή στο πίσω μέρος της οθόνης, πιάστε και κρατήστε σταθερά το κάτω μέρος και τη λαβή της οθόνης.

Ενδεχόμενη πτώση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στον εξοπλισμό.



 ΠΡΟΣΟΧΗ	Προσέξτε να μην χτυπήσετε τα χέρια σας. Εάν ασκήσετε ξαφνικά δύναμη στην οθόνη για να ρυθμίσετε το ύψος ή τη γωνία της, τα χέρια σας μπορεί να χτυπηθούν και να τραυματιστούν.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Μη φράζετε τις σχισμές αερισμού του περιβλήματος. - Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις σχισμές αερισμού. - Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε σημείο χωρίς καλό εξαερισμό ή σε στενό χώρο. - Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είναι πεσμένη ή αναποδογυρισμένη. Το φράξιμο των σχισμών αερισμού εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα και ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Μην αγγίζετε το βύσμα ρεύματος με υγρά χέρια. Τυχόν επαφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από το βύσμα ρεύματος. Έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε εύκολα το βύσμα ρεύματος σε περίπτωση προβλήματος για αποφυγή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Καθαρίζετε περιοδικά το χώρο γύρω από το βύσμα ρεύματος και τη σχισμή αερισμού της οθόνης. Ενδεχόμενη παρουσία σκόνης, νερού ή λαδιού πάνω σε αυτήν την περιοχή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Αν την καθαρίσετε ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ρεύματος, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Αν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα αφού κλείσετε το διακόπτη ρεύματος, για λόγους ασφαλείας και εξοικονόμησης ενέργειας.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Η απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους νόμους της περιοχής ή της χώρας κατοικίας σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τους χρήστες στην περιοχή του ΕΟΧ και στην Ελβετία:
Κάθε σοβαρό περιστατικό που προκύπτει σχετικά με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον Κατασκευαστή και στην Αρμόδια αρχή του Κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Προειδοποίηση σχετικά με αυτήν την οθόνη

Ενδείξεις χρήσης

Το συγκεκριμένο προϊόν ενδείκνυται για χρήση κατά την προβολή ραδιολογικών εικόνων, για εξέταση, ανάλυση και διάγνωση από καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό. Η οθόνη δεν προορίζεται για μαστογραφία.

Προσοχή

- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για διαγνωστική χρήση in vitro.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να μην καλύπτεται από εγγύηση σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ισχύουν μόνο εφόσον χρησιμοποιούνται τα καλώδια ρεύματος που παρέχονται μαζί με το προϊόν και τα καλώδια σήματος που καθορίζονται από την EIZO.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα προϊόντα αξεσουάρ Eizo που καθορίζονται από την Eizo με το συγκεκριμένο προϊόν.

Προφυλάξεις για τη χρήση

- Ορισμένα εξαρτήματα (όπως η οθόνη LCD και ο ανεμιστήρας) ενδέχεται να υποστούν φθορά αν χρησιμοποιηθούν μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος. Ελέγχετε περιοδικά ότι λειτουργούν κανονικά.
- Αν αλλάξει η εικόνα της οθόνης μετά την απεικόνιση της ίδιας εικόνας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παραμείνει ένα μετείκασμα (afterimage). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης ή τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να αποφύγετε την απεικόνιση της ίδιας εικόνας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ένα μετείκασμα ενδέχεται να εμφανιστεί ακόμα και έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την εικόνα που απεικονίζεται. Για να επιλύσετε ένα τέτοιο φαινόμενο, αλλάξτε την εικόνα ή διατηρήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για πολλές ώρες.
- Χρειάζονται αρκετά λεπτά για να σταθεροποιηθεί η απεικόνιση στην οθόνη. Προτού χρησιμοποιήσετε την οθόνη, περιμένετε μερικά λεπτά ή περισσότερο μετά την ενεργοποίηση της οθόνης ή μετά την επαναφορά της από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Αν η οθόνη παραμείνει αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες ή είδωλα. Για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της οθόνης, σας συνιστούμε να σβήνετε ενίοτε την οθόνη.
- Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD έχει συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης, π.χ. χρήση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ο οπίσθιος φωτισμός ενδέχεται να φτάσει γρηγορότερα στο τέλος ζωής του και να χρειάζεται αντικατάσταση. Αν η οθόνη μαυρίσει ή αρχίσει να τρεμουλιάζει, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της EIZO.
- Η οθόνη μπορεί να έχει ελαττωματικά εικονοστοιχεία (pixel) ή μικρό αριθμό φωτεινών κουκκίδων. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της ίδιας της οθόνης LCD και δεν συνιστά δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Μην πιέζετε με δύναμη την επιφάνεια ή το εξωτερικό πλαίσιο της οθόνης LCD, επειδή μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες κατά την απεικόνιση, όπως μοτίβα παρεμβολών κ.λπ. Αν ασκείται συνεχής πίεση στην επιφάνεια της οθόνης LCD, ο υγρός κρύσταλλος ενδέχεται να υποστεί φθορά ή η οθόνη LCD ενδέχεται να υποστεί ζημιά. (Αν παραμένουν σημάδια πάνω στην οθόνη LCD λόγω της πίεσης, αφήστε να προβάλλεται μια λευκή ή μαύρη οθόνη. Το σύμπτωμα μπορεί να εξαλειφθεί.)

- Μη χαράζετε και μην πιέζετε την οθόνη LCD με αιχμηρά αντικείμενα, επειδή έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη LCD. Μην επιχειρήσετε να σκουπίσετε την οθόνη με χαρτί, επειδή μπορεί να τη χαράξετε.
- Μην αγγίζετε τον ενσωματωμένο αισθητήρα βαθμονόμησης (ενσωματωμένο μπροστινό αισθητήρα). Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την ακρίβεια μέτρησης ή να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.
- Ανάλογα με το περιβάλλον, η τιμή την οποία που μετρείται από τον ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή που υποδεικνύεται σε μεμονωμένο μετρητή φωτεινότητας.
- Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υδρατμών στην επιφάνεια ή το εσωτερικό αυτού του προϊόντος αν τοποθετηθεί σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, αν η θερμοκρασία αυξηθεί απότομα ή αν μεταφερθεί από χώρο με χαμηλή θερμοκρασία σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία. Μην ενεργοποιήσετε το προϊόν σε τέτοια περίπτωση. Περιμένετε να εξατμιστούν οι υδρατμοί, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

Για μακρά χρήση της οθόνης

Έλεγχος ποιότητας

- Η ποιότητα παρουσίασης σε κάθε οθόνη επηρεάζεται από το επίπεδο της ποιότητας των σημάτων εισόδου και τη φθορά του προϊόντος. Φροντίστε να πραγματοποιείτε οπτικούς ελέγχους και περιοδικές δοκιμές σταθερότητας (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της κλίμακας του γκρι) για συμμόρφωση προς τα ιατρικά πρότυπα/τις ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για την εφαρμογή σας και να εκτελείτε βαθμονόμηση όποτε είναι απαραίτητο. Με το λογισμικό ελέγχου ποιότητας RadiCS (προαιρετικό) της οθόνης έχετε τη δυνατότητα να εκτελείτε έλεγχο της ποιότητας, ο οποίος πληροί τα ιατρικά πρότυπα/τις ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες.
- Περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά αφότου ανάψετε την οθόνη ή μετά την επαναφορά της οθόνης από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, για να εκτελέσετε διάφορες δοκιμές ελέγχου ποιότητας, εργασίες βαθμονόμησης ή ρυθμίσεις της οθόνης.
- Συνιστούμε τη ρύθμιση των οθονών στο συνιστώμενο ή σε χαμηλότερο επίπεδο φωτεινότητας ώστε να μειώνονται οι μεταβολές φωτεινότητας που προκαλούνται από τη μακρά χρήση και να διατηρείται σταθερή η φωτεινότητα.
- Για να ρυθμίσετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ενσωματωμένου αισθητήρα βαθμονόμησης (ενσωματωμένου μπροστινού αισθητήρα) έτσι ώστε να είναι αντίστοιχα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων εξωτερικού αισθητήρα που πωλείται χωριστά, εκτελέστε συσχέτιση του ενσωματωμένου μπροστινού αισθητήρα με τον εξωτερικό αισθητήρα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό RadiCS (προαιρετικό παρελκόμενο)/RadiCS LE (περιλαμβάνεται). Εκτελώντας κατά διαστήματα τη διαδικασία συσχέτισης μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι μετρήσεις του ενσωματωμένου μπροστινού αισθητήρα θα είναι πάντα εξίσου ορθές με τις μετρήσεις του εξωτερικού αισθητήρα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συσχέτιση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού RadiCS/RadiCS LE.

Προσοχή

- Η κατάσταση προβολής της οθόνης μπορεί να αλλάξει απροσδόκητα λόγω σφάλματος λειτουργίας ή μη αναμενόμενης αλλαγής ρύθμισης. Αφού ρυθμιστεί η οθόνη, συνιστάται να χρησιμοποιείται με τους διακόπτες χειρισμού κλειδωμένους. Για λεπτομέρειες όσον αφορά τη ρύθμιση, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).

Καθαρισμός

- Συνιστάται περιοδικός καθαρισμός ώστε το προϊόν να συνεχίσει να μοιάζει καινούργιο και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του.

- Οι λεκέδες στην επιφάνεια του προϊόντος αφαιρούνται εάν βρέξετε με λίγο νερό ένα μαλακό πανί ή εάν χρησιμοποιήσετε το ScreenCleaner της εταιρείας μας και σκουπίσετε απαλά.

Προσοχή

- Μην επιτρέπετε να έρθουν υγρά σε άμεση επαφή με την οθόνη. Σε περίπτωση που έρθουν, σκουπίστε αμέσως.
- Μην επιτρέπετε να εισέλθουν υγρά στα κενά ή μέσα στο προϊόν.
- Κατά τη χρήση χημικών ουσιών για τον καθαρισμό ή την απολύμανση, χημικές ουσίες όπως το οινόπνευμα και τα απολυμαντικά ενδέχεται να αλλοιώσουν τη γυαλάδα, να προκαλέσουν θάμπωμα ή ξεθώριασμα του προϊόντος, και, επίσης, να υποβαθμίσουν την ποιότητα της εικόνας. Μην χρησιμοποιείτε συχνά χημικές ουσίες.
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ διαλυτικό μέσο, βενζίνη καθαρισμού, κερί ή διαβρωτικό καθαριστικό, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.
Πώς να ελέγξετε: Ανοίξτε τη σελίδα www.eizoglobal.com και πληκτρολογήστε «disinfect» στο πλαίσιο αναζήτησης για αναζήτηση.

Απολύμανση με χημικές ουσίες

- Όταν απολυμαίνετε προϊόντα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες που έχουν ελεγχθεί από εμάς (δείτε τον πίνακα παρακάτω). Σημειώστε ότι κατά τη χρήση αυτών των χημικών ουσιών δεν διασφαλίζεται το γεγονός ότι το προϊόν δεν θα καταστραφεί ή δεν θα υποστεί φθορά.

Κατηγορία	Τύπος χημικής ουσίας	Παράδειγμα προϊόντος
Με βάση το οινόπνευμα	Ισοπροπυλική αλκοόλη (αιθυλική αλκοόλη)	Αιθανόλη
Με βάση το οινόπνευμα	Ισοπροπανόλη	Ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA)
Χλώριο	Υποχλωριώδες νάτριο	Purelox
Διγουανίδη	Γλυκονική χλωρεξιδίνη	Διάλυμα Hibitane
Με βάση το οινόπνευμα	Χλωριούχο βενζαλκόνιο	Welpas
Με βάση την αλδεΐδη	Γλουταράλη	SteriHyde
Με βάση την αλδεΐδη	Γλουταράλη	Cidex Plus28
Επαμφοτερίζον τασιενεργό	Υδροχλωρική αλκυλοδιαμινοαιθυλογλυκίνη	Διάλυμα Satenidin

Για άνετη χρήση της οθόνης

- Αν η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή ή φωτεινή, ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα στα μάτια σας. Φροντίστε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
- Αν κοιτάτε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, κουράζονται τα μάτια σας. Φροντίστε να κάνετε διάλειμμα 10 λεπτών κάθε μία ώρα.
- Κοιτάξτε την οθόνη από κατάλληλη απόσταση και γωνία.

Προειδοποιήσεις και ευθύνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

- Η ενημέρωση υλικολογισμικού θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω της EIZO Corporation ή του διανομέα της.

- Εάν η EIZO Corporation ή ο διανομέας της ζητήστε την ενημέρωση του υλικολογισμικού, ενημερώστε το αμέσως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	3
Σημαντικό	3
Θέση του σήματος υπόδειξης ασφαλείας	3
Σύμβολα πάνω στη μονάδα	3
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	5
ΠΡΟΣΟΧΗ	9
Προειδοποίηση σχετικά με αυτήν την οθόνη	12
Ενδείξεις χρήσης	12
Προφυλάξεις για τη χρήση	12
Για μακρά χρήση της οθόνης	13
Έλεγχος ποιότητας	13
Καθαρισμός	13
Απολύμανση με χημικές ουσίες	14
Για άνετη χρήση της οθόνης	14
Προειδοποιήσεις και ευθύνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο	14
1 Εισαγωγή	18
1.1 Λειτουργίες	18
1.1.1 Ελεύθερη διάταξη	18
1.1.2 Απλή καλωδίωση	18
1.1.3 Υποστηρίζεται η απεικόνιση σημάτων βίντεο και η τροφοδοσία με ένα μόνο καλώδιο σύνδεσης USB Type-C	18
1.1.4 Υβριδική μονόχρωμη και έγχρωμη προβολή	19
1.1.5 Έλεγχος ποιότητας	19
1.1.6 Λειτουργία σταθμού αγκύρωσης	19
1.1.7 Διαθέτει λειτουργία φωτισμού (RadiLight)	19
1.1.8 Σχέδιο που εξοικονομεί χώρο	20
1.1.9 Λειτουργία οθόνης από το ποντίκι και το πληκτρολόγιο	20
1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας	21
1.2.1 EIZO LCD Utility Disk	21
1.2.2 RadiCS LE	22
1.2.3 Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό RadiCS LE	22
1.3 Στοιχεία ελέγχου και λειτουργίες	23
1.3.1 Μπροστινή πλευρά	23
1.3.2 Πίσω πλευρά	24
2 Εγκατάσταση/Σύνδεση	26
2.1 Πριν από την εγκατάσταση	26
2.1.1 Συνθήκες εγκατάστασης	26
2.2 Σύνδεση καλωδίων	27

2.3	Σύνδεση του RadiLight Focus (φως εργασίας)	32
2.4	Ενεργοποίηση της τροφοδοσίας	32
2.5	Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης	33
2.6	Σύνδεση του καλύμματος υποδοχής	34
2.7	Χρήση RadiLight Area / RadiLight Focus	35
3	Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»	36
4	Προδιαγραφές	38
4.1	Λίστα προδιαγραφών	38
4.1.1	Τύπος.....	38
4.1.2	Οθόνη LCD	38
4.1.3	Σήματα βίντεο	38
4.1.4	USB.....	38
4.1.5	Δίκτυο.....	39
4.1.6	Τροφοδοσία	39
4.1.7	Φυσικές προδιαγραφές	39
4.1.8	Απαιτήσεις Λειτουργικού Περιβάλλοντος	40
4.1.9	Συνθήκες μεταφοράς / αποθήκευσης.....	40
4.2	Υποστηριζόμενες αναλύσεις	41
4.3	Παρελκόμενα	41
	Παράρτημα.....	42
	Ιατρικό πρότυπο.....	42
	Ταξινόμηση του εξοπλισμού	42
	Πληροφορίες ΗΜΣ	43
	Περιβάλλοντα προβλεπόμενης χρήσης	43
	Τεχνικές περιγραφές	44


1 Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια έγχρωμη οθόνη LCD της EIZO.

1.1 Λειτουργίες

1.1.1 Ελεύθερη διάταξη

- Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει τις λειτουργίες PbyP (Picture by Picture, εικόνα δίπλα σε εικόνα) και PinP (Picture in Picture, εικόνα μέσα σε εικόνα) οι οποίες επιτρέπουν την ταυτόχρονη απεικόνιση έως και τριών σημάτων.

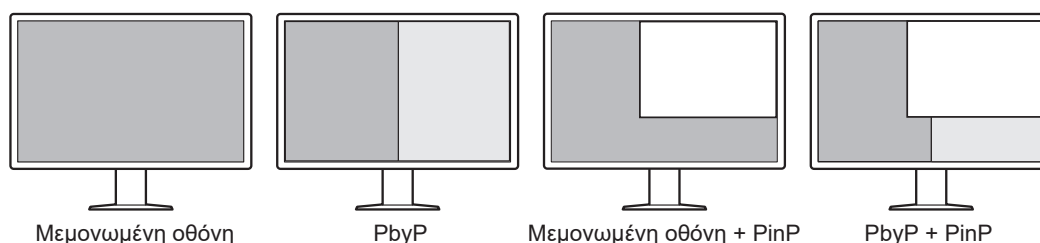


- Η οθόνη παρέχει τη λειτουργία One Cable PbyP, η οποία προβάλλει εικόνες στη λειτουργία PbyP με ένα μόνο καλώδιο σήματος.

1.1.2 Απλή καλωδίωση

Η οθόνη διαθέτει ακροδέκτη εξόδου USB Type-C® (USB-C®).


Από τον ακροδέκτη εξόδου είναι εφικτή η έξοδος σήματος σε διαφορετική οθόνη.

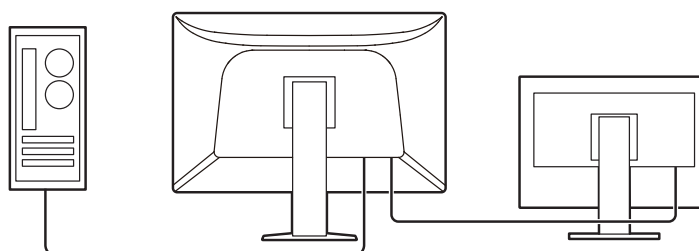

1.1.3 Υποστηρίζεται η απεικόνιση σημάτων βίντεο και η τροφοδοσία με ένα μόνο καλώδιο σύνδεσης USB Type-C

Το προϊόν αυτό διαθέτει υποδοχή USB-C και υποστηρίζει τη μετάδοση σημάτων βίντεο (λειτουργία Alt DisplayPort™) καθώς και την τροφοδοσία (παροχή ισχύος USB).

Παρέχει ισχύ έως 94 W σε συνδεδεμένους υπολογιστές notebook, όταν χρησιμοποιείται ως εξωτερική οθόνη.

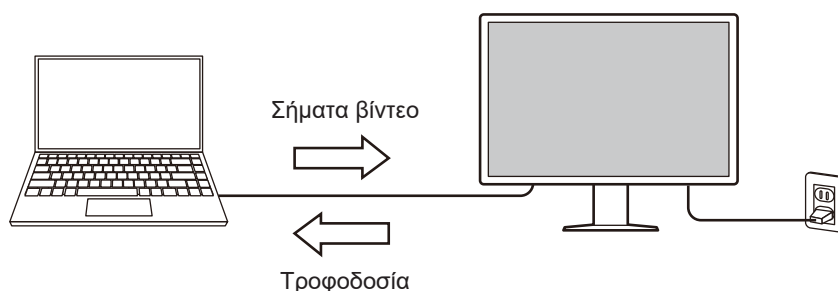

Σημείωση

- Για την απεικόνιση σημάτων βίντεο, η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τη μετάδοση σημάτων βίντεο (λειτουργία Alt DisplayPort).
- Για να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία φόρτισης, η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τη φόρτιση συσκευής μέσω της λειτουργίας παροχής ισχύος USB.
- Μόνο όταν χρησιμοποιούνται τα παρακάτω καλώδια USB, είναι εφικτή η παροχή ισχύος έως και 94 W:
 - CC150SS81G-5A (Περιλαμβάνεται)
- Η φόρτιση των συνδεδεμένων συσκευών είναι εφικτή ακόμα και όταν η οθόνη εκτελεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

1.1.4 Υβριδική μονόχρωμη και έγχρωμη προβολή


Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Hybrid Gamma PXL (Γάμμα υβριδικής προβολής εικονοστοιχείων) το προϊόν διαχωρίζει αυτόματα τα μονόχρωμα και τα έγχρωμα τμήματα της ίδιας εικόνας σε επίπεδο εικονοστοιχείων και τα προβάλλει αντίστοιχα με τις βέλτιστες διαβαθμίσεις.

1.1.5 Έλεγχος ποιότητας

- Η συγκεκριμένη οθόνη διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα βαθμονόμησης (ενσωματωμένο μπροστινό αισθητήρα). Ο αισθητήρας αυτός δίνει επιτρέπει στην οθόνη να εκτελεί βαθμονόμηση (SelfCalibration (αυτοβαθμονόμηση)) και έλεγχο της κλίμακας του γκρι ανεξάρτητα.
- Με τη χρήση του παρεχόμενου RadiCS LE μπορείτε να πραγματοποιείτε βαθμονόμηση οθόνης και διαχείριση ιστορικού.
- Με το λογισμικό ελέγχου ποιότητας RadiCS της οθόνης έχετε τη δυνατότητα να εκτελείτε έλεγχο της ποιότητας ο οποίος πληροί τα ιατρικά πρότυπα/τις ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες.

1.1.6 Λειτουργία σταθμού αγκύρωσης

Η οθόνη αυτή διαθέτει υποδοχή LAN και USB hub που της επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός αγκύρωσης. Συνδέοντας ένα καλώδιο USB-C, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σταθερό περιβάλλον δικτύου ακόμα και σε υπολογιστές notebook ή σε συσκευές tablet που δεν διαθέτουν υποδοχές LAN. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιφερειακές συσκευές, συμβατές με USB και να φορτίσετε smartphone (ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας σταθμού αγκύρωσης» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).

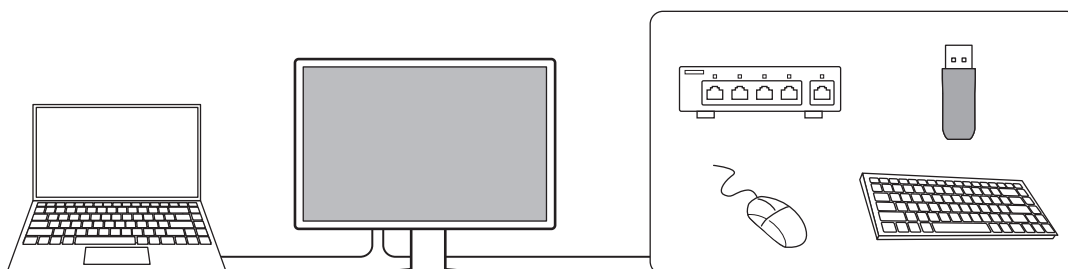
**1.1.7 Διαθέτει λειτουργία φωτισμού (RadiLight)**

RadiLight Area (οπίσθιος φωτισμός)

- Το RadiLight Area είναι μια λειτουργία οπίσθιου φωτισμού ενσωματωμένη στην οθόνη. Φωτίζει έμμεσα ένα δωμάτιο από το πίσω μέρος της οθόνης, επιτρέποντας την αποτελεσματική ακτινολογική αντίληψη σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό.


RadiLight Focus (φως εργασίας)

- Το RadiLight Focus είναι ένα αποσπώμενο φως εργασίας. Μπορεί να παρέχει φωτισμό για τον χώρο εργασίας σας κατά την ανάγνωση, τη συγγραφή εγγράφων ή τη χρήση πληκτρολογίου.

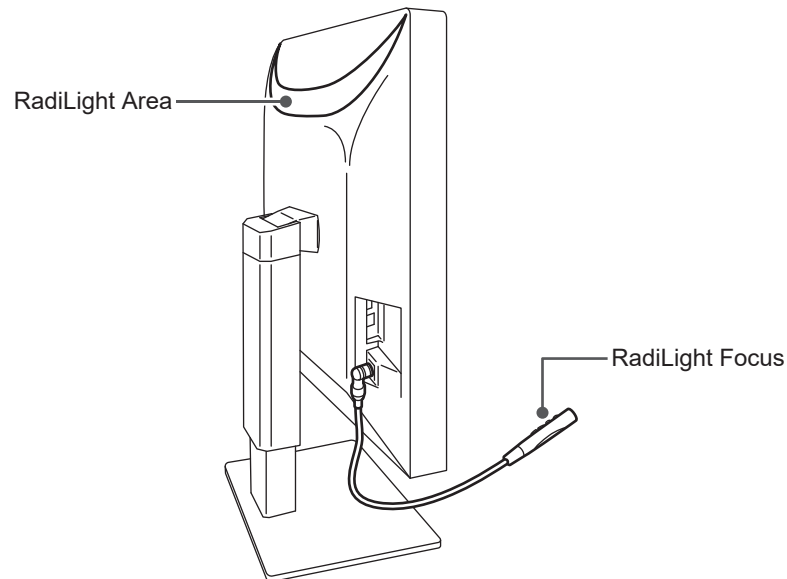

1.1.8 Σχέδιο που εξοικονομεί χώρο

Η οθόνη διαθέτει πολλές υποδοχές USB (upstream). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς υπολογιστές μέσω ενός συνόλου συσκευών USB (στο οποίο περιλαμβάνονται ποντίκι, πληκτρολόγιο κ.λπ.).

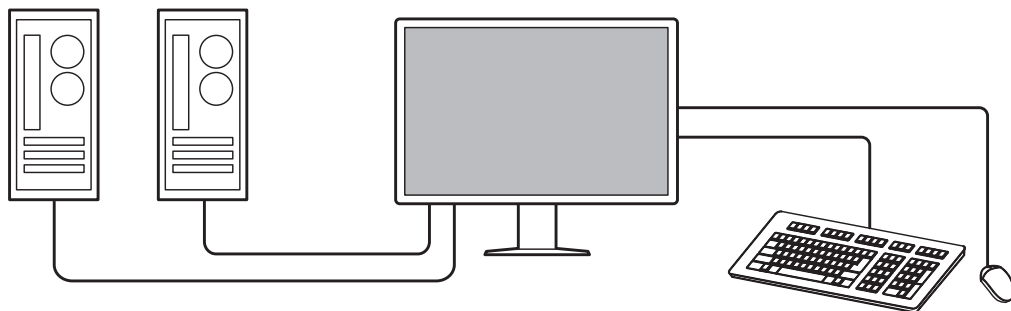

1.1.9 Λειτουργία οθόνης από το ποντίκι και το πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό ελέγχου ποιότητας RadiCS/RadiCS LE της οθόνης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη και το πληκτρολόγιο για να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες της οθόνης:

- Εναλλαγή λειτουργιών CAL Switch
- Εναλλαγή σημάτων εισόδου
- Λειτουργία που εκχωρεί κάθε λειτουργία CAL Switch σε κάποιο τμήμα της οθόνης και παρουσιάζει μια εικόνα (Point-and-Focus)
- Παρουσίαση ή απόκρυψη του υποπαραθύρου PinP (Hide-and-Seek)
- Εναλλαγή υπολογιστών που χρησιμοποιούν συσκευές USB (Switch-and-Go)
- Μετάβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Backlight Saver)
- Μια λειτουργία που αυξάνει προσωρινά τη φωτεινότητα για να βελτιώσει την ορατότητα των διαγνωστικών εικόνων (Instant Backlight Booster)

Σημείωση

- Με το λογισμικό RadiCS/RadiCS LE της οθόνης έχετε τη δυνατότητα προβολής ή απόκρυψης του υποπαραθύρου PinP και ταυτόχρονης εναλλαγής των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των συσκευών USB. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία ρύθμισης ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού RadiCS/RadiCS LE.

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε αν στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα είδη που ακολουθούν. Αν λείπει ή είναι κατεστραμμένο κάποιο από τα είδη αυτά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της EIZO.

Σημείωση

- Συνιστούμε να φυλάξετε το κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας, ώστε να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε όποτε χρειαστεί να μετακινήσετε ή να μεταφέρετε το συγκεκριμένο προϊόν.

- Οθόνη
- Καλώδιο τροφοδοσίας



- Καλώδιο ψηφιακού σήματος (DisplayPort - DisplayPort): PP300-V14 x 2



- Καλώδιο ψηφιακού σήματος (HDMI - HDMI): HH300PR x 1



- Καλώδιο USB 2.0 (USB-A - USB-B): UU300 x 2



- Καλώδιο USB-C (USB-C σε USB-C): CC150SS81G-5A x 1



- Κάλυμμα υποδοχής (αριστερά)
- Κάλυμμα υποδοχής (δεξιά)
- RadiLight Focus (φως εργασίας)
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Οδηγίες χρήσης

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

Το CD-ROM περιέχει τα είδη που ακολουθούν. Για τις διαδικασίες εκκίνησης του λογισμικού ή αναφοράς στα αρχεία ανατρέξτε στο αρχείο «Readme.txt» που θα βρείτε στο δίσκο.

- Αρχείο Readme.txt
- Λογισμικό ελέγχου ποιότητας RadiCS LE της οθόνης (για Windows)
- Εγχειρίδιο χρήσης
 - Οδηγίες χρήσης αυτής της οθόνης
 - Εγχειρίδιο εγκατάστασης οθόνης
 - Εγχειρίδιο χρήσης RadiCS LE
- Εξωτερικές διαστάσεις

1.2.2 RadiCS LE

Το λογισμικό RadiCS LE σας επιτρέπει να εκτελέσετε τις δυνατότητες ελέγχου ποιότητας και τις λειτουργίες της οθόνης που παρατίθενται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το λογισμικό ή τις διαδικασίες ρύθμισης ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού RadiCS LE.

Έλεγχος ποιότητας

- Εκτέλεση βαθμονόμησης
- Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε λίστα και δημιουργία έκθεσης για τις δοκιμές
- Καθορισμός του στόχου αυτοβαθμονόμησης και του χρονοπρογράμματος εκτέλεσής του

Λειτουργίες οθόνης

- Εναλλαγή λειτουργιών CAL Switch
- Εναλλαγή σημάτων εισόδου
- Λειτουργία που εκχωρεί κάθε λειτουργία CAL Switch σε κάποιο τμήμα της οθόνης και παρουσιάζει μια εικόνα (Point-and-Focus)
- Παρουσίαση ή απόκρυψη του υποπαραθύρου PinP (Hide-and-Seek)
- Εναλλαγή υπολογιστών που χρησιμοποιούν συσκευές USB (Switch-and-Go)
- Μετάβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Backlight Saver)
- Μια λειτουργία που αυξάνει προσωρινά τη φωτεινότητα για να βελτιώσει την ορατότητα των διαγνωστικών εικόνων (Instant Backlight Booster)
- Μια λειτουργία που ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης για να αντιστοιχεί στο επίπεδο φωτός του περιβάλλοντος όταν ορίζεται στη λειτουργία «Text» (Κείμενο) (Auto Brightness Control)

Προσοχή

- Οι προδιαγραφές του λογισμικού RadiCS LE ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού RadiCS LE είναι διαθέσιμη για λήψη από την ιστοσελίδα μας: (www.eizoglobal.com)


1.2.3 Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό RadiCS LE

Για πληροφορίες όσον αφορά την εγκατάσταση και τη χρήση του λογισμικού RadiCS LE ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης RadiCS LE (στο CD-ROM).

Όποτε χρησιμοποιείτε το λογισμικό RadiCS LE, συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο σύνδεσης της οθόνης ανατρέξτε στην ενότητα [2.2 Σύνδεση καλωδίων](#) [► 27].


1.3 Στοιχεία ελέγχου και λειτουργίες

1.3.1 Μπροστινή πλευρά

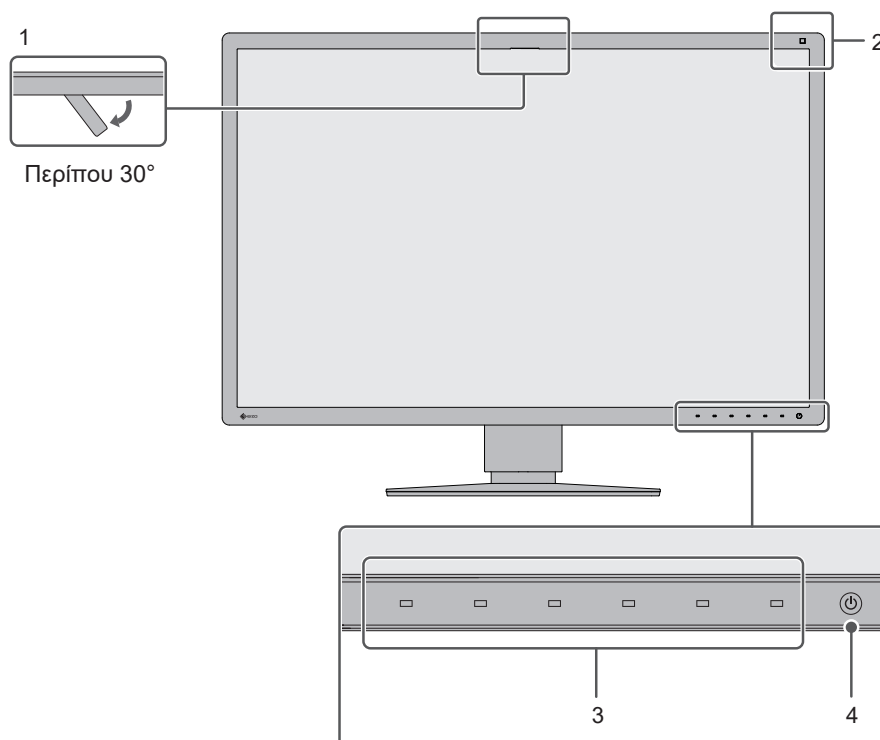

1. Ενσωματωμένος μπροστινός αισθητήρας (μετακινήσιμος)	Ο αισθητήρας αυτός χρησιμοποιείται για την εκτέλεση βαθμονόμησης και ελέγχου της κλίμακας του γκρι.
2. Αισθητήρας φωτός	Ο αισθητήρας αυτός μετρά το φως του περιβάλλοντος. Η μέτρηση του φωτός περιβάλλοντος πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού ελέγχου ποιότητας RadiCS/RadiCS LE.
3. Διακόπτες χειρισμού	Παρουσιάζεται ο οδηγός λειτουργίας. Καθορίστε τα μενού με βάση τον οδηγό λειτουργίας.
4. Διακόπτης ρεύματος	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ρεύματος. Το ενδεικτικό του διακόπτη ανάβει όποτε ενεργοποιείτε τη συσκευή. Το χρώμα του ενδεικτικού διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης. Πράσινο: Κανονική λειτουργία, Πορτοκαλί: Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, Απενεργοποίηση: Κεντρική τροφοδοσία ή τροφοδοσία απενεργοποιημένη

1.3.2 Πίσω πλευρά

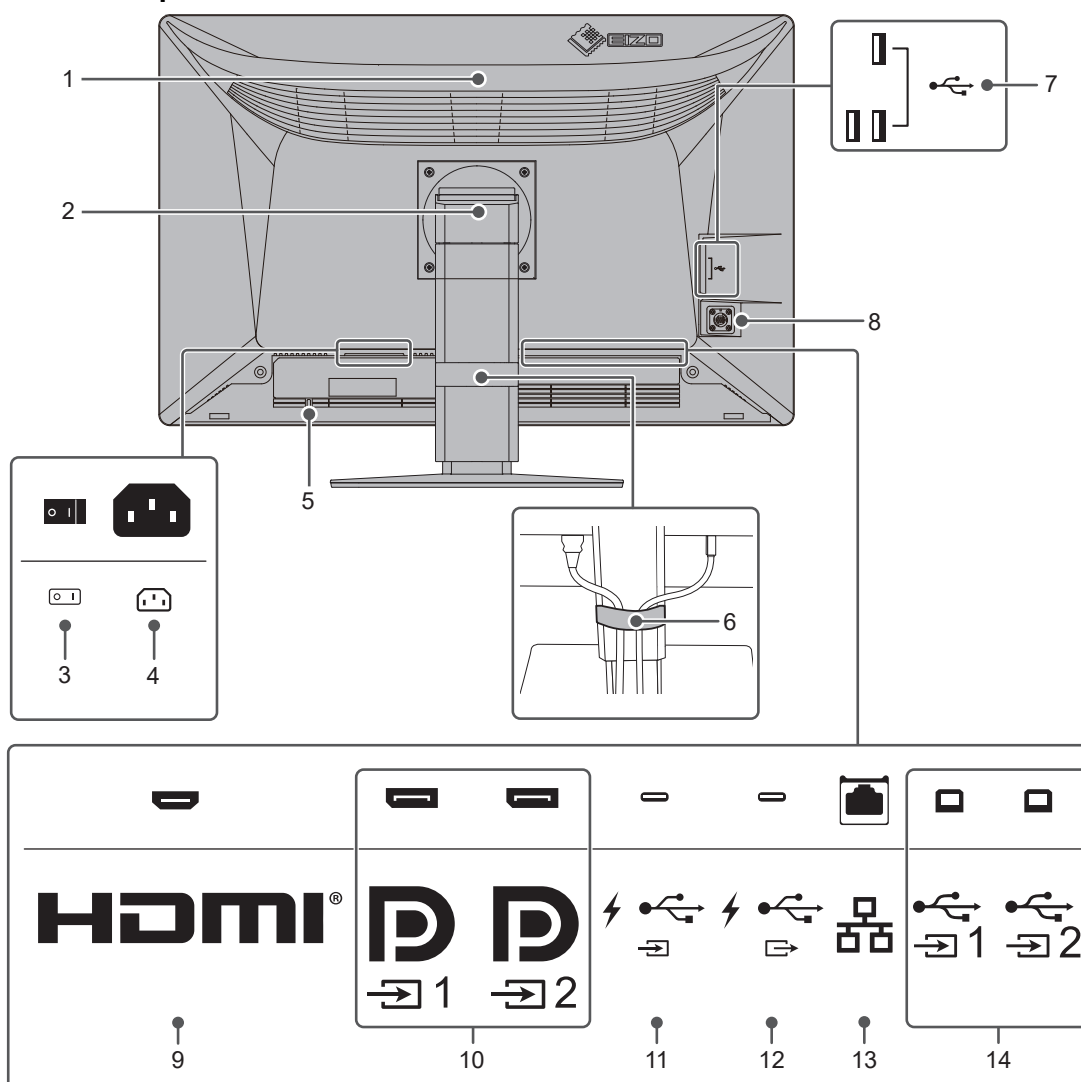

1. RadiLight Area (οπίσθιος φωτισμός)	Λειτουργία οπίσθιου φωτισμού ενσωματωμένη στην οθόνη. Φωτίζει έμμεσα ένα δωμάτιο από το πίσω μέρος της οθόνης.
2. Βάση	Ρυθμίζει το ύψος και τη γωνία (κλίση και οριζόντια περιστροφή) της οθόνης.
3. Διακόπτης τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την κεντρική τροφοδοσία. ○ : Απενεργοποίηση, : Ενεργοποίηση
4. Υποδοχή τροφοδοσίας	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος.
5. Σχισμή κλειδώματος ασφαλείας	Συμμορφώνεται με το σύστημα ασφαλείας MicroSaver της Kensington.
6. Θήκη καλωδίου	Επιτρέπει την τακτοποίηση των καλωδίων.
7. Υποδοχή USB-A (downstream)	Χρησιμοποιεί για τη σύνδεση σε περιφερειακή συσκευή USB (ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας σταθμού αγκύρωσης» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).
8. Υποδοχή φωτός εργασίας	Συνδέεται με το RadiLight Focus.
9. Υποδοχή HDMI	Χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με υπολογιστή με έξοδο HDMI.
10. Υποδοχή DisplayPort	Χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με υπολογιστή με έξοδο DisplayPort.

11. Υποδοχή USB-C (upstream)	Χρησιμοποιεί για τη σύνδεση σε υπολογιστή με έξοδο USB-C. Επίσης, μεταδίδει το απαραίτητο σήμα USB για τη χρήση λογισμικού που απαιτεί σύνδεση USB ή τη λειτουργία σταθμού αγκύρωσης (ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας σταθμού αγκύρωσης» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).
12. Υποδοχή USB-C (downstream)	Για να δημιουργήσετε αλυσιδωτή σύνδεση, συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή USB-C upstream κάποιας άλλης οθόνης. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε μια περιφερειακή συσκευή USB (ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας σταθμού αγκύρωσης» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).
13. Υποδοχή LAN	Χρησιμοποιεί για τη σύνδεση σε διανομέα δικτύου ή δρομολογητή μέσω καλωδίου LAN με σκοπό τη χρήση της σύνδεσης δικτύου της λειτουργίας σταθμού αγκύρωσης (ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας σταθμού αγκύρωσης» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).
14. Υποδοχή USB-B (upstream)	Συνδέεται με υπολογιστή κατά τη χρήση λογισμικού που απαιτεί σύνδεση USB σε υπολογιστή χωρίς υποδοχή USB-C ή κατά τη χρήση της λειτουργίας USB hub του συγκεκριμένου προϊόντος.

2 Εγκατάσταση/Σύνδεση

2.1 Πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα [ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ \[► 3\]](#) και φροντίστε να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες.

Αν τοποθετήσετε το συγκεκριμένο προϊόν επάνω σε λακαρισμένο γραφείο, ενδέχεται να κολλήσει η μπογιά στο κάτω μέρος της βάσης λόγω της σύνθεσης του καουτσούκ. Ελέγξτε την επιφάνεια του γραφείου πριν από τη χρήση.

2.1.1 Συνθήκες εγκατάστασης

Κατά την τοποθέτηση της οθόνης σε ράφι, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τα πλαϊνά μέρη, το πίσω και το πάνω μέρος της οθόνης.

Προσοχή
• Τοποθετήστε την οθόνη σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να μην ανακλάται φως πάνω στην οθόνη.

2.2 Σύνδεση καλωδίων


Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη, ο υπολογιστής και τα περιφερειακά δεν λειτουργούν πριν από τη σύνδεση.
- Κατά την αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας οθόνης σας με το συγκεκριμένο προϊόν, ανατρέξτε στην ενότητα [4.2 Υποστηριζόμενες αναλύσεις \[► 41\]](#) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή για την ανάλυση και την κάθετη συχνότητα σάρωσης και να χρησιμοποιήσετε αυτές που είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη οθόνη προτού συνδέσετε τον υπολογιστή.
- Αν είναι δύσκολο να εισαγάγετε τα καλώδια, ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης.

1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος.

Ελέγξτε τα σχήματα των υποδοχών και συνδέστε τα καλώδια.


Σε οθόνη ενός παραθύρου

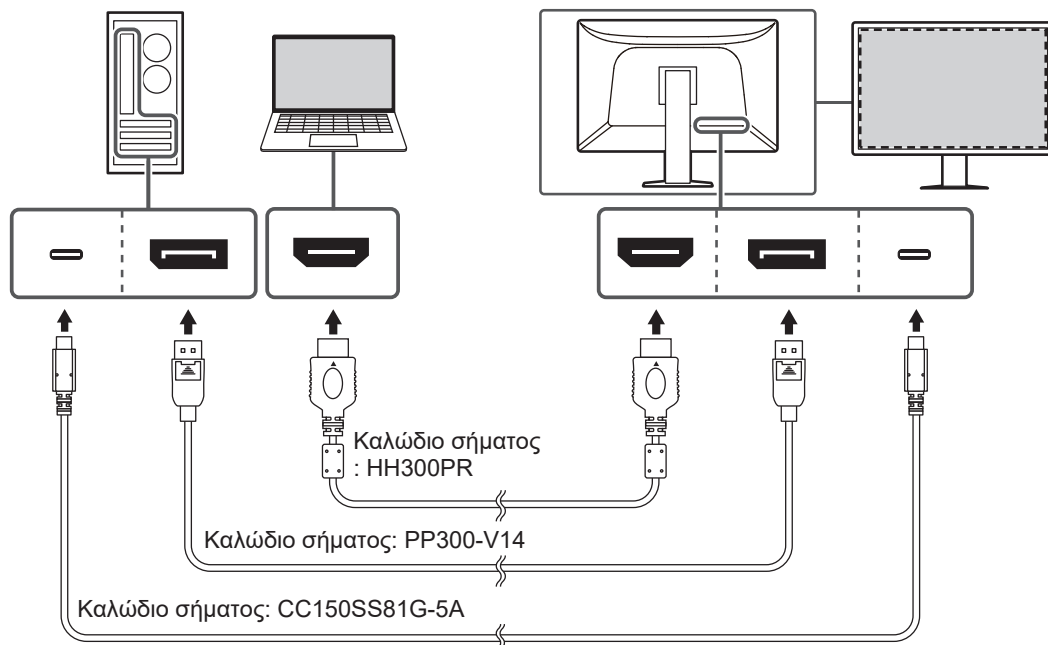

Προσοχή


- Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, εμφανίζεται το σήμα της υποδοχής DisplayPort 1. Εάν θέλετε να εμφανίσετε το σήμα από άλλη υποδοχή, αλλάξτε το σήμα εισόδου (ανατρέξτε στην ενότητα «Εναλλαγή σημάτων εισόδου» στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης).
- Εάν χρησιμοποιείτε το USB-C όχι μόνο για την προβολή βίντεο αλλά και για τον έλεγχο ποιότητας της οθόνης με το RadiCS / RadiCS LE και τη σύνδεση συσκευών USB (περιφερειακά συμβατά με USB), πρέπει να ρυθμίσετε το «USB Selection» σε «USB-C» στο μενού Ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
- Για τα σήματα HDMI®, ενδέχεται να απεικονίζονται σε περιορισμένο εύρος.

Σε απεικόνιση PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2)

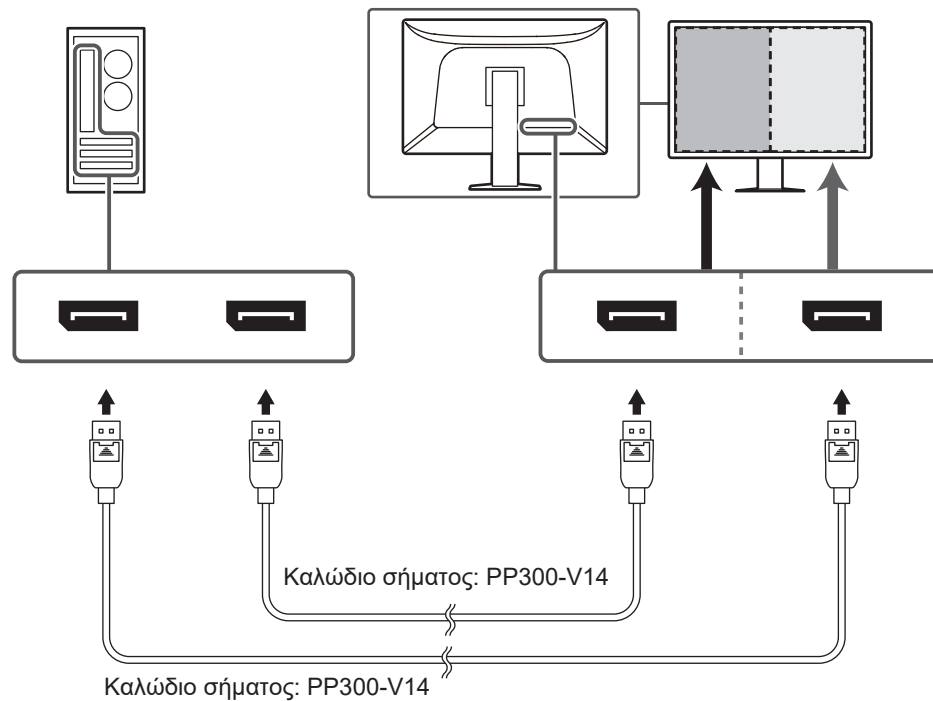

Προσοχή


- Για να εκτελέσετε απεικόνιση PbyP (DisplayPort 1/DisplayPort 2), πρέπει να ορίσετε την επιλογή «PbyP Settings» στο μενού Ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
- Κατά την απεικόνιση PbyP από δύο υπολογιστές, ορισμένες πτυχές του ποιοτικού ελέγχου, όπως η βαθμονόμηση, ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

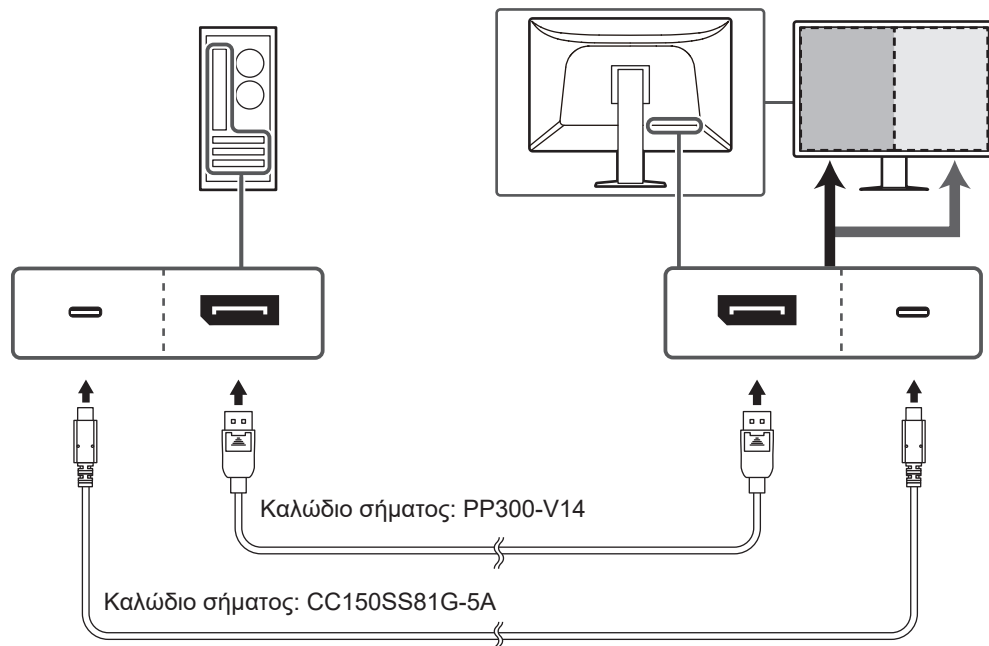Σε απεικόνιση PbyP (One Cable PbyP)**Προσοχή**

- Για να εκτελέσετε απεικόνιση PbyP (One Cable PbyP), απαιτείται σύνδεση στην υποδοχή DisplayPort 1 ή στην υποδοχή USB-C (Upstream: ). Επιπλέον, πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση «PbyP Settings» στο μενού Ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
- Εάν χρησιμοποιείτε το USB-C όχι μόνο για την προβολή βίντεο αλλά και για τον έλεγχο ποιότητας της οθόνης με το RadiCS / RadiCS LE και τη σύνδεση συσκευών USB (περιφερειακά συμβατά με USB), πρέπει να ρυθμίσετε το «USB Selection» σε «USB-C» στο μενού Ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).

Σε προβολή (υποπαραθύρου) PinP

Παράδειγμα: Χρήση της υποδοχής HDMI

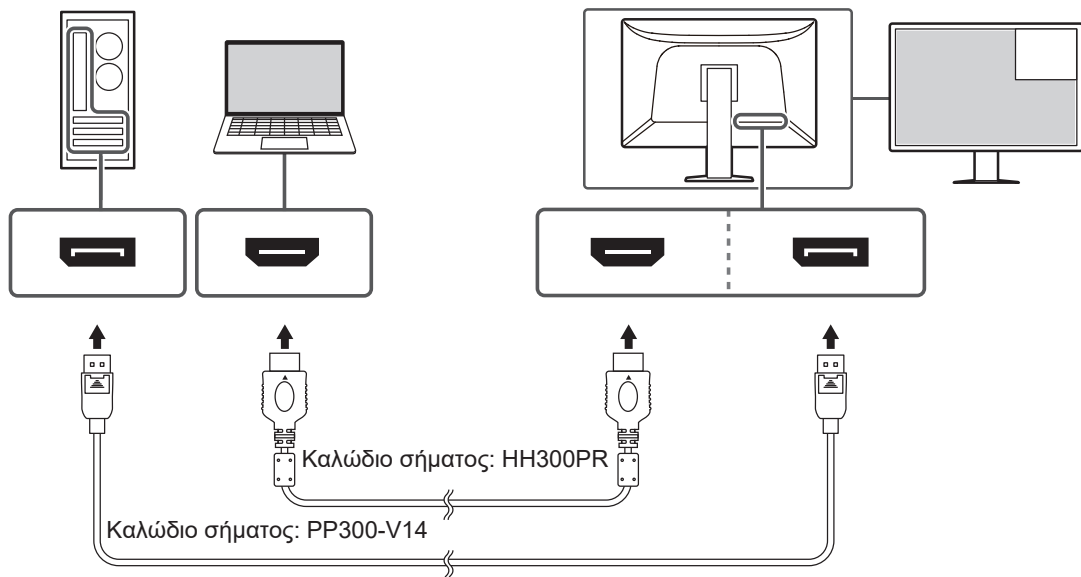


Προσοχή

- Για να εκτελέσετε την απεικόνιση PinP (υποπαραθύρου), πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση «PinP Settings» στο μενού Ρυθμίσεις. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
- Στην περίπτωση απεικόνισης σήματος HDMI σε μεμονωμένη οθόνη, δεν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας απεικόνισης PinP (υποπαραθύρου).

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Κατά την αλυσιδωτή σύνδεση άλλων οθονών


Η είσοδος σήματος στην υποδοχή DisplayPort 1 ή στην υποδοχή USB-C (Upstream: ) θα λειτουργεί ως έξοδος σε κάποια άλλη οθόνη.

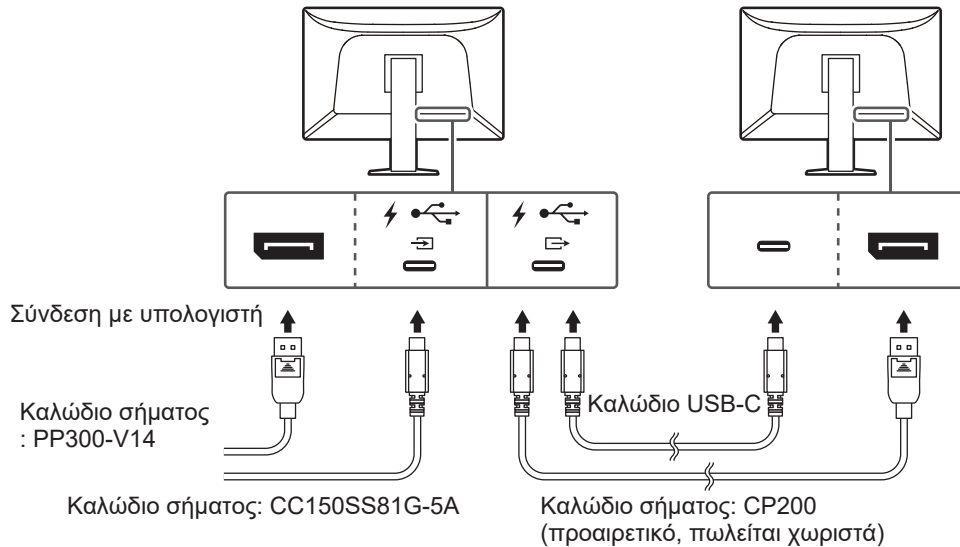

Προσοχή

- Αν χρειαστείτε πληροφορίες όσον αφορά τις οθόνες και τις κάρτες γραφικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλυσιδωτή σύνδεση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της EIZO: (www.eizoglobal.com)
- Για τη δημιουργία αλυσιδωτής σύνδεσης, απαιτείται σύνδεση στην υποδοχή DisplayPort 1 ή στην υποδοχή USB-C (Upstream: ) . Επιπλέον, πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση «Daisy Chain» στο μενού Ρυθμίσεις διαχειριστή. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
- Ένα κάλυμμα συνδέεται στην υποδοχή USB-C (downstream: ) από προεπιλογή. Αφαιρέστε το κάλυμμα κατά τη χρήση της υποδοχής.

2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα ρεύματος και την υποδοχή τροφοδοσίας στην οθόνη.
Περάστε το καλώδιο ρεύματος μέσα στην οθόνη ως το τέρμα.
3. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση USB-C και χρησιμοποιείτε το RadiCS / RadiCS LE ή συνδέετε συσκευές USB (περιφερειακά συμβατά με USB) στην οθόνη, συνδέστε ένα καλώδιο USB 2.0 από την υποδοχή USB-B της οθόνης στην υποδοχή USB-A του υπολογιστή.

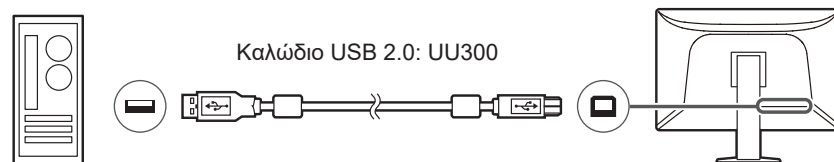


Προσοχή

- Όταν συνδέετε την οθόνη σε υπολογιστή στον οποίο υπάρχει εγκατεστημένο το λογισμικό RadiCS/RadiCS LE, συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή USB-B 1 () ή USB-C (upstream: ) .
- Όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή USB-B 2 () , αφαιρέστε το κάλυμμα πριν τη χρήση. Επίσης, αλλάξτε τη ρύθμιση «USB Selection» στο μενού Ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή USB» του Εγχειριδίου εγκατάστασης).

2.3 Σύνδεση του RadiLight Focus (φως εργασίας)

Συνδέστε το RadiLight Focus (φως εργασίας) στην υποδοχή του φωτός εργασίας της οθόνης.

Μπορεί να συνδεθεί μόνο προς τα κάτω, κάθετα προς την υποδοχή.

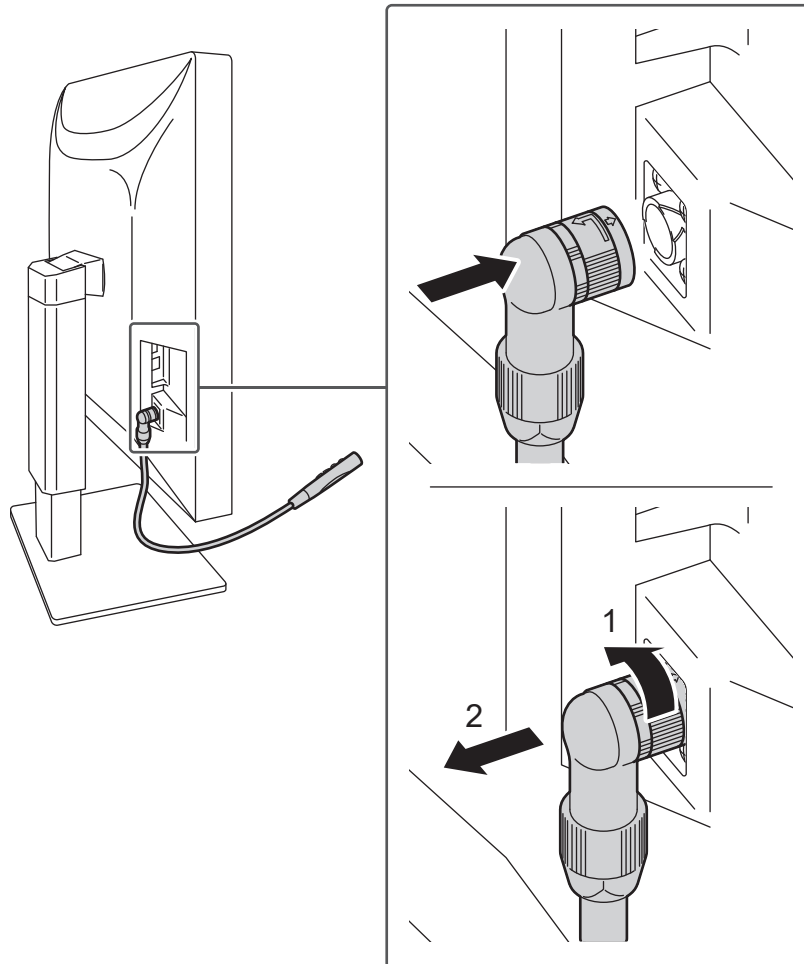

Για να το αφαιρέσετε, τραβήξτε το προς τα έξω ενώ στρέψετε το τμήμα σύνδεσης με την οθόνη προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το 1 στην εικόνα.

2.4 Ενεργοποίηση της τροφοδοσίας

1. Αγγίξτε το  για να ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος στην οθόνη. Το ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας της οθόνης ανάβει με πράσινο χρώμα. Εάν το ενδεικτικό δεν ανάβει, ανατρέξτε στην ενότητα [3 Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»](#) [\[► 36\]](#).

Σημείωση

- Όταν αγγίξετε οποιονδήποτε από τους διακόπτες χειρισμού εκτός του  με την οθόνη απενεργοποιημένη, το  αρχίζει να αναβοσβήνει για να σας ενημερώσει πού βρίσκεται ο διακόπτης τροφοδοσίας.

2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Εμφανίζεται η εικόνα της οθόνης. Αν δεν εμφανιστεί εικόνα, ανατρέξτε στην ενότητα [3 Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»](#) [\[► 36\]](#) για πρόσθετη ενημέρωση.

Προσοχή


- Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά ή αλλάζετε τον τρόπο σύνδεσης, οι ρυθμίσεις οθόνης όπως η ανάλυση και η κλίμακα απεικόνισης ενδέχεται να μην είναι οι κατάλληλες. Ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις για τον υπολογιστή έχουν διαμορφωθεί σωστά.
- Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, συνιστάται να σβήνετε την οθόνη από το κουμπί τροφοδοσίας. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη, μπορείτε να διακόψετε την παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο ή να αποσυνδέσετε το βύσμα ρεύματος ώστε να διακοπεί εντελώς η τροφοδοσία.

Σημείωση

- Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της οθόνης αποφεύγοντας την υποβάθμιση της φωτεινότητάς της και να μειώσετε την κατανάλωση ισχύος, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 - Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του υπολογιστή ή της οθόνης.
 - Φροντίστε να απενεργοποιείτε την οθόνη μετά τη χρήση της.

2.5 Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης


Κρατήστε την πάνω και την κάτω ή την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης και με τα δύο χέρια και ρυθμίστε το ύψος, την κλίση και την οριζόντια περιστροφή της οθόνης στην καταλληλότερη θέση εργασίας.

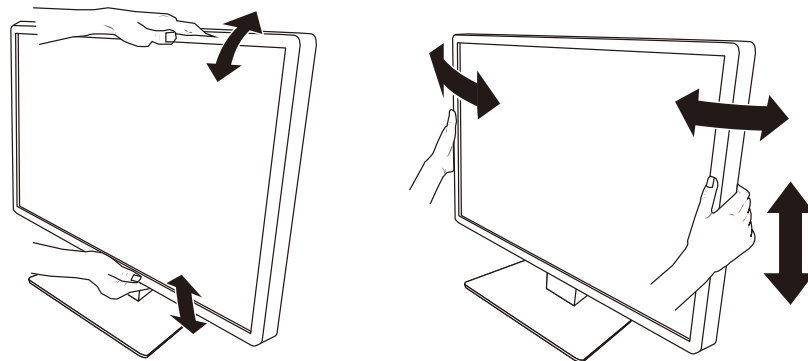**Προσοχή**


- Αφού τελειώσετε την προσαρμογή, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Αφού ρυθμίσετε το ύψος και τη γωνία, περάστε τα καλώδια μέσα από τη θήκη συγκράτησής τους.
- Όταν ρυθμίζετε τη γωνία ή τη θέση της οθόνης ενώ το φως εργασίας είναι συνδεδεμένο, προσέξτε να μην ασκείτε πίεση στο φως εργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην υποδοχή ή στον βραχίονα.

2.6 Σύνδεση του καλύμματος υποδοχής

1. Τακτοποιήστε τα καλώδια στη θήκη καλωδίων.

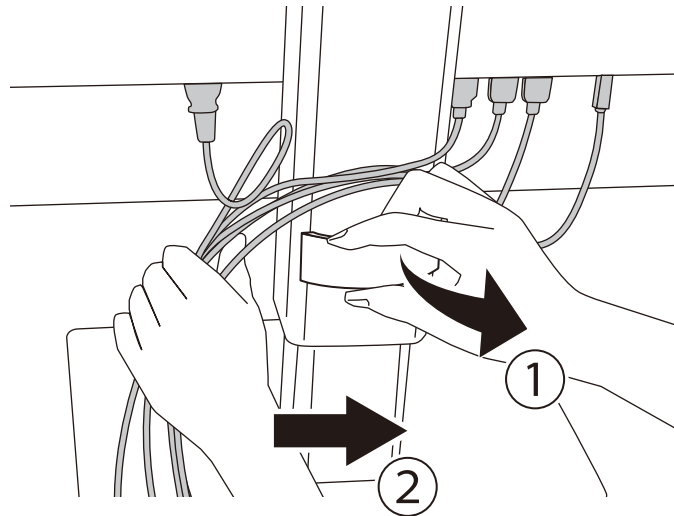

2. Συνδέστε το κάλυμμα υποδοχής.

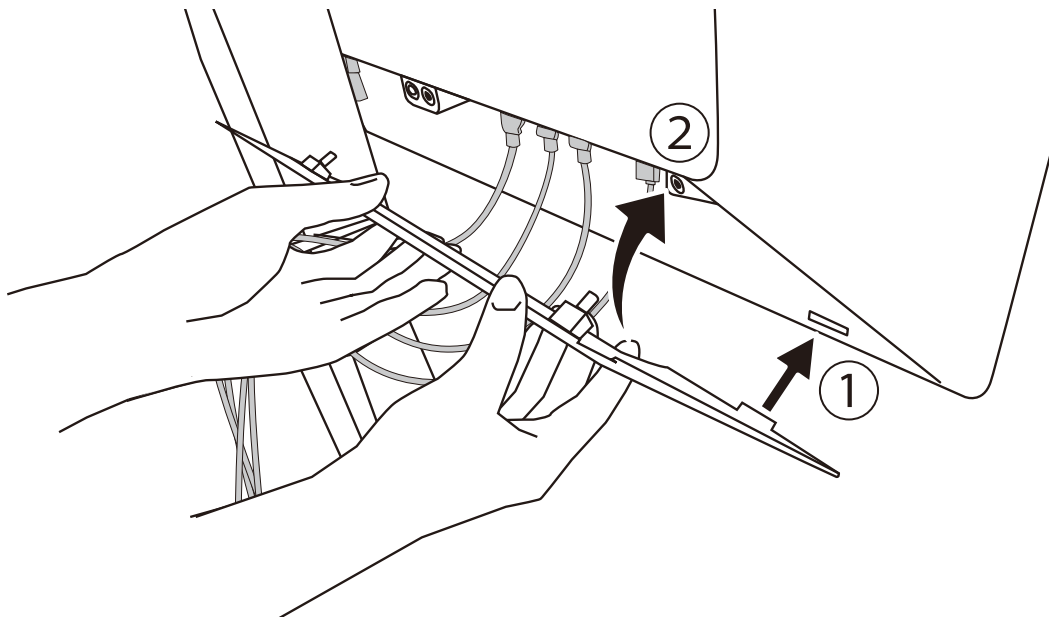

Παράδειγμα: Σύνδεση του καλύμματος υποδοχής(δεξιά)

Προσοχή


- Φροντίστε να το συνδέσετε με ασφάλεια για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο εξαερισμό στο εσωτερικό της οθόνης.

Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα υποδοχής, τραβήξτε το προς το μέρος σας.

2.7 Χρήση RadiLight Area / RadiLight Focus

1. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι.
2. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το RadiLight Area ή το RadiLight Focus.
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του RadiLight Area.

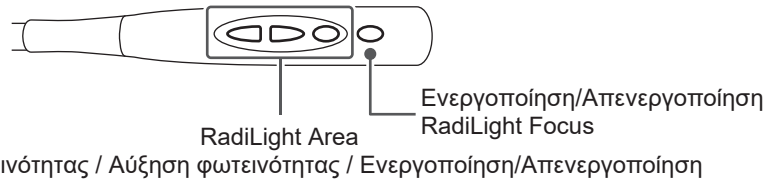

Προσοχή

- Λόγω των διαφορών στα LED, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στα χρώματα και τη φωτεινότητα ακόμη και για το ίδιο προϊόν.
- Στα παρακάτω περιβάλλοντα, ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται επαρκής φωτισμός κατά τη χρήση του RadiLight Area.
 - Εάν η απόσταση από τον τοίχο ή την οροφή είναι μεγάλη
 - Εάν ο τοίχος ή η οροφή είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν αντανακλούν καλά ή έχουν σκούρα χρώματα
- Κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης του RadiLight Focus, ρυθμίστε τη γωνία κρατώντας όχι μόνο την άκρη αλλά και τον βραχίονα.

Σημείωση

- Για λεπτομέρειες όσον αφορά τη ρύθμιση του RadiLight Area, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).

3 Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»

Το ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας δεν ανάβει

- Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο όπως πρέπει.
- Ανοίξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης.
- Πατήστε το .
- Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον ξανά μετά από μερικά λεπτά.

Το ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας ανάβει: Πράσινο

- Αυξήστε την τιμή στις επιλογές «Brightness», «Contrast» ή «Gain» στο Μενού ρύθμισης. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
- Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον ξανά μετά από μερικά λεπτά.

Το ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας ανάβει: Πορτοκαλί

- Αλλάξτε το σήμα εισόδου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
- Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.
- Ελέγξτε αν ο υπολογιστής έχει ενεργοποιηθεί.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στις υποδοχές του αντίστοιχου σήματος εισόδου.
- Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον ξανά.

Το ενδεικτικό του διακόπτη τροφοδοσίας αναβοσβήνει: Πορτοκαλί, πράσινο

- Πραγματοποιήστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EIZO. Έπειτα, κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον ξανά ύστερα από μερικά λεπτά.

Εμφανίζεται στο μήνυμα «No Signal» στην οθόνη.

Παράδειγμα:




- Επειδή ορισμένοι υπολογιστές δεν επιτρέπουν την έξοδο του σήματος αμέσως μετά την ενεργοποίησή τους, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται παραπάνω.
- Ελέγξτε αν ο υπολογιστής έχει ενεργοποιηθεί.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στις υποδοχές του αντίστοιχου σήματος εισόδου.
- Η υποδοχή USB-C (downstream: ) χρησιμοποιείται ως υποδοχή εξόδου για την αλυσιδωτή σύνδεση. Η οθόνη δεν εμφανίζεται ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

- Αλλάξτε το σήμα εισόδου. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης (στο CD-ROM).
- Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τον ξανά.


Εμφανίζεται στο μήνυμα «Signal Error» στην οθόνη.

Παράδειγμα:



- Ελέγξτε αν ο υπολογιστής είναι ρυθμισμένος για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ανάλυσης και συχνότητας κατακόρυφης σάρωσης της οθόνης (βλέπε [4.2 Υποστηριζόμενες αναλύσεις \[► 41\]](#)).
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- Επιλέξτε μια κατάλληλη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη της κάρτας γραφικών.

Εμφανίζεται το μήνυμα «DP Unsupported» στην οθόνη



- Ελέγξτε αν το συνδεδεμένο καλώδιο είναι ένα καλώδιο σήματος συνιστώμενο από την EIZO.
- Ελέγξτε αν η υποδοχή USB-C της συνδεδεμένης συσκευής υποστηρίζει την έξοδο σημάτων βίντεο (λειτουργία Alt DisplayPort). Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Συνδέστε ένα καλώδιο DisplayPort ή ένα καλώδιο HDMI.

4 Προδιαγραφές

4.1 Λίστα προδιαγραφών

4.1.1 Τύπος

RX670	Αντιθαμβωτική
RX670-AR	Αντιανακλαστική

4.1.2 Οθόνη LCD

Τύπος	Έγχρωμη (IPS)
Οπίσθιος φωτισμός	LED
Μέγεθος	30,0" (76,2 cm)
Ανάλυση	3280 κουκκίδες x 2048 γραμμές
Περιοχή απεικόνισης (Ο x Κ)	645,5 mm x 403,0 mm
Βήμα εικονοστοιχείων (Ο x Κ)	0,197 mm x 0,197 mm
Χρώματα οθόνης	Χρώμα 10 bit (DisplayPort / USB-C): Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα (από μια παλέτα περίπου 543 δισεκατομμυρίων χρωμάτων) 8-bit (DisplayPort / HDMI): 16,77 εκατομμύρια χρώματα (από μια παλέτα περίπου 543 δισεκατομμυρίων χρωμάτων)
Γωνία θέασης (Ο / Κ, τυπικές)	178° / 178°
Συνιστώμενη φωτεινότητα	500 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης (τυπικός)	1800:1
Χρόνος απόκρισης (τυπικός)	25 ms (μαύρο -> λευκό -> μαύρο)

4.1.3 Σήματα βίντεο

Ακροδέκτες εισόδου	DisplayPort x 2, USB-C (λειτουργία Alt DisplayPort) x 1, HDMI x 1
Ακροδέκτης εξόδου	USB-C (λειτουργία Alt DisplayPort) x 1
Οριζόντια συχνότητα σάρωσης	31 kHz – 127 kHz
Κάθετη συχνότητα σάρωσης ^{*1}	59 Hz – 61 Hz (720 x 400: 69 Hz – 71 Hz)
Λειτουργία συγχρονισμού καρέ	59 Hz – 61 Hz
Συχνότητα κουκκίδων	25 MHz – 440 MHz

^{*1} Η κάθετη συχνότητα σάρωσης που υποστηρίζεται διαφέρει ανάλογα με την ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [4.2 Υποστηριζόμενες αναλύσεις](#) ► [41](#)].

4.1.4 USB

Υποδοχή	Upstream	USB-C x 1, USB-B x 2
	Downstream	USB-A x 3, USB-C x 1
Πρότυπο	Προδιαγραφή USB, Αναθεώρηση 2.0	
Ταχύτητα επικοινωνίας	480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps	
Τροφοδοσία	Upstream	USB-C: Μέγιστη ισχύς 94 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,7 A)
	Downstream	USB-A: Μέγιστη ισχύς ανά υποδοχή 500 mA USB-C: Μέγιστη ισχύς 15 W (5 V/3 A)

4.1.5 Δίκτυο

Υποδοχή	RJ-45 (προσαρμογέας USB LAN)
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα ^{*1}	Windows 11 Windows 10 (32 bit / 64 bit) macOS Sierra (έκδ. 10.12) ή μεταγενέστερη έκδοση
Ενσύρματο LAN	IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)

^{*1} Η υποστήριξη EIZO θα λήξει όταν λήξει η υποστήριξη του προμηθευτή λειτουργικού συστήματος.

4.1.6 Τροφοδοσία

Είσοδος	100 – 240 VAC $\pm$ 10 %, 50 / 60 Hz, 2,80 – 1,20 A
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	279 W ή λιγότερο ^{*1}
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	0,5 W ή λιγότερο ^{*2}
Κατάσταση αναμονής	0,5 W ή λιγότερο ^{*3}

^{*1} Όταν είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό φορτίο, «Mode»: «4-Custom», «Brightness»: «100%», Το RadiLight Focus είναι ενεργοποιημένο, η φωτεινότητα του RadiLight Area είναι μέγιστη.

^{*2} Κατά τη χρήση της εισόδου DisplayPort ενώ δεν είναι συνδεδεμένη η υποδοχή USB upstream, «Power Save»: «High», «DP Power Save»: «On», «One Cable PbyP»: «Off», Το RadiLight Focus είναι συνδεδεμένο, το RadiLight Focus είναι απενεργοποιημένο, δεν έχει συνδεθεί εξωτερικό φορτίο

^{*3} Όταν δεν είναι συνδεδεμένη η υποδοχή USB upstream, «DP Power Save»: «On», «One Cable PbyP»: «Off», Το RadiLight Focus είναι συνδεδεμένο, το RadiLight Focus είναι απενεργοποιημένο, δεν έχει συνδεθεί εξωτερικό φορτίο

4.1.7 Φυσικές προδιαγραφές

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	682,0 mm x 490,5 mm – 590,5 mm x 225,0 mm (κλίση: 0°) 682,0 mm x 534,7 mm – 634,7 mm x 295,2 mm (κλίση: 30°)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) (χωρίς βάση)	682,0 mm x 441,0 mm x 88,0 mm
Καθαρό βάρος	Περίπου 15,8 kg
Καθαρό βάρος (χωρίς βάση)	Περίπου 11,7 kg
Περιοχή τιμών ρύθμισης ύψους	100 mm (κλίση: 0°)
Κλίση	Επάνω 30°, κάτω 5°
Οριζόντια περιστροφή	70°

4.1.8 Απαιτήσεις Λειτουργικού Περιβάλλοντος

Θερμοκρασία	0°C–35°C
Υγρασία	Σχετική υγρασία 20 %–80 % (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Πίεση αέρα	540 hPa–1060 hPa

4.1.9 Συνθήκες μεταφοράς / αποθήκευσης

Θερμοκρασία	-20°C–60°C
Υγρασία	Σχετική υγρασία 10 %–90 % (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Πίεση αέρα	200 hPa–1060 hPa

4.2 Υποστηριζόμενες αναλύσεις

Η οθόνη υποστηρίζει τις παρακάτω αναλύσεις:

✓: Υποστηρίζεται, -: Δεν υποστηρίζεται

Ανάλυση	Κάθετη συχνότητα σάρωσης (Hz)	DisplayPort/USB-C			HDMI	
		Οθόνη ενός παραθύρου	Απεικόνισ η PbyP	Απεικόνισ η PinP	Οθόνη ενός παραθύρου	Απεικόνισ η PinP
640 x 480	59,940	✓	✓	✓	✓	✓
640 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
720 x 400	70,087	✓	✓	✓	✓	✓
720 x 480	59,940	-	-	-	✓	✓
720 x 480	60,000	-	-	-	✓	✓
800 x 600	60,317	✓	✓	✓	✓	✓
1024 x 768	60,004	✓	✓	✓	✓	✓
1200 x 1600	59,963	-	-	✓	-	✓
1200 x 1920	59,940	-	-	✓	-	✓
1280 x 720	59,940	-	-	-	✓	✓
1280 x 720	60,000	-	-	-	✓	✓
1280 x 1024	60,020	✓	✓	✓	✓	✓
1600 x 1200	60,000	✓	✓	✓	✓	✓
1640 x 2048	59,985	-	✓ ^{*1}	-	-	-
1920 x 1080	59,940	-	-	-	✓	✓
1920 x 1080	60,000	-	-	-	✓	✓
1920 x 1200	59,950	-	-	✓ ^{*1}	-	✓ ^{*1}
2560 x 1600	59,972	-	-	-	✓ ^{*2}	-
3280 x 2048	59,981	✓ ^{*1}	-	-	✓ ^{*3}	-

*1 Συνιστώμενη ανάλυση

*2 Συνιστώμενη ανάλυση όταν το «LMM Mode (HDMI)» έχει οριστεί σε «On» στο «Administrator Settings»

*3 Συνιστώμενη ανάλυση όταν το «LMM Mode (HDMI)» έχει οριστεί σε «Off» στο «Administrator Settings»

4.3 Παρελκόμενα

Τα παρελκόμενα που ακολουθούν διατίθενται χωριστά.

Για τις πιο πρόσφατα επικαιροποιημένες πληροφορίες όσον αφορά τα προαιρετικά παρελκόμενα και για πληροφορίες όσον αφορά την πιο πρόσφατη συμβατή κάρτα γραφικών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας.

(www.eizoglobal.com)

Κιτ βαθμονόμησης	RadiCS UX2 έκδ. 5.1.3 ή μεταγενέστερη RadiCS Version Up Kit έκδ. 5.1.3 ή μεταγενέστερη
Λογισμικό Network QC Management	RadiNET Pro έκδ. 5.1.3 ή μεταγενέστερη
Κιτ καθαρισμού	Καθαριστικό οθόνης (ScreenCleaner)
Προσαρμογέας VESA για Thin Client ή Mini-PC	PCSK-R1
Καλώδιο σήματος (USB-C – DisplayPort)	CP200

Παράρτημα

Ιατρικό πρότυπο

- Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το τελικό σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του IEC60601-1.
- Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μπορεί να δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα που μπορεί να επηρεάσουν, να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη ή να επιβάλλουν περιορισμούς στη λειτουργία της. Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου τέτοια φαινόμενα μπορούν να αποφευχθούν.

Ταξινόμηση του εξοπλισμού

- Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία: Κλάση I
- Κλάση ΗΜΣ: IEC60601-1-2 Ομάδα 1 Κλάση B
- Ταξινόμηση ιατρικής συσκευής (ΕΕ): Κλάση I
- Τρόπος λειτουργίας: Συνεχής
- Κλάση IP: IPX0

Πληροφορίες ΗΜΣ

Η RadiForce RX670 διαθέτει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την κατάλληλη απεικόνιση ιατρικών εικόνων.

Περιβάλλοντα προβλεπόμενης χρήσης

Η RadiForce RX670 προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα που καθορίζονται παρακάτω.

- Επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, όπως κλινικές και νοσοκομεία
- Χώροι κατοικίας και διαμονής που συνιστούν οικιακά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης

Τα παρακάτω περιβάλλοντα δεν ενδείκνυνται για τη χρήση της RadiForce RX670 :

- Οικιακά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης, εξαιρουμένων των χώρων κατοικίας
- Κοντά σε χειρουργικό εξοπλισμό υψηλών συχνοτήτων, π.χ. ηλεκτροχειρουργικά μαχαίρια
- Κοντά σε εξοπλισμό θεραπείας με βραχεία κύματα
- Αίθουσα με θωράκιση έναντι ραδιοσυχνοτήτων στα συστήματα ιατρικού εξοπλισμού για μαγνητικές τομογραφίες (MRI)
- Ειδικά περιβάλλοντα θωρακισμένων τοποθεσιών
- Προϊόντα εγκατεστημένα σε οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ασθενοφόρων
- Άλλα ειδικά περιβάλλοντα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για τη RadiForce RX670 απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και χρειάζεται να γίνει εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή την ενότητα «Πληροφορίες για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)» και την ενότητα «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ» στο παρόν έγγραφο και να τηρήσετε πιστά τις οδηγίες που ακολουθούν κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη RadiForce RX670 δίπλα σε άλλον εξοπλισμό ούτε να τη στοιβάξετε επάνω σε άλλον εξοπλισμό. Αν χρειαστεί να το κάνετε, πρέπει να παρακολουθήσετε τον εξοπλισμό ή το σύστημα για να εξακριβώσετε αν λειτουργεί κανονικά με τη διάρθρωση στην οποία θα χρησιμοποιηθεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε φορητό εξοπλισμό επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων, φροντίστε να απέχει τουλάχιστον 30 εκατοστά (12 ίντσες) από κάθε εξάρτημα της RadiForce RX670, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να υποβαθμιστούν οι επιδόσεις του εξοπλισμού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κάθε άτομο που συνδέει πρόσθετο εξοπλισμό στο εξάρτημα εισόδου σήματος ή στα εξαρτήματα εξόδου σήματος, κατά τη διαμόρφωση ενός ιατρικού συστήματος, αναλαμβάνει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC60601-1-2.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε τις υποδοχές εισόδου/εξόδου κατά τη χρήση του RadiForce RX670. Διαφορετικά, η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να επηρεαστεί.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε οπωσδήποτε τα καλώδια που είναι προσαρτημένα στο προϊόν ή τα καλώδια που συνιστώνται από την EIZO. Αν χρησιμοποιήσετε διαφορετικά καλώδια από αυτά που συνιστώνται από την EIZO για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η πιθανότητα δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή να μειωθεί η ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του εξοπλισμού, οπότε δεν θα λειτουργεί όπως πρέπει.

Υποδοχή σήματος	Μέγ. μήκος καλωδίων	Θωράκιση	Πυρήνας φερρίτη	Συνιστώμενο καλώδιο
DisplayPort	3 m	Με θωράκιση	Χωρίς πυρήνες φερρίτη	PP300-V14
HDMI	3 m	Με θωράκιση	Με πυρήνες φερρίτη	HH300PR
USB-C (upstream)	1,5 m	Με θωράκιση	Χωρίς πυρήνες φερρίτη	CC150SS81G-5A
USB-C (downstream)	2 m	Με θωράκιση	Χωρίς πυρήνες φερρίτη	-
USB-B (upstream)	3 m	Με θωράκιση	Με πυρήνες φερρίτη	UU300/MD-C93
USB-A (downstream)	3 m	Με θωράκιση	Χωρίς πυρήνες φερρίτη	-
Ethernet	30 m	Χωρίς θωράκιση	Χωρίς πυρήνες φερρίτη	-
Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος (ή έξοδος εναλλασσόμενου ρεύματος)	3 m	Χωρίς θωράκιση	Χωρίς πυρήνες φερρίτη	Με καλώδιο γείωσης

Τεχνικές περιγραφές

Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Η RadiForce RX670 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.

Ο πελάτης ή ο χρήστης της RadiForce RX670 οφείλει να διασφαλίσει ότι η RadiForce RX670 χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών	Συμμόρφωση	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR11	Ομάδα 1	Η RadiForce RX670 χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για τις εσωτερικές λειτουργίες της. Ως εκ τούτου, οι ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει είναι πολύ χαμηλές και δεν υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν οιαδήποτε παρεμβολή σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό που βρίσκεται κοντά τους.
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR11	Κλάση Β	Η RadiForce RX670 ενδείκνυται για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, καθώς και σε όσες συνδέονται απευθείας στο δημόσιο δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, το οποίο παρέχει ρεύμα σε κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.
Αρμονικές εκπομπές IEC61000-3-2	Κλάση Δ	
Εκπομπές λόγω διακυμάνσεων τάσης/ τρεμοσβήματος IEC61000-3-3	Συμμορφώνεται	

Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η RadiForce RX670 έχει υποβληθεί σε δοκιμές ως προς τα παρακάτω επίπεδα συμμόρφωσης (C) σύμφωνα με τις απαιτήσεις δοκιμών (T) για περιβάλλοντα επαγγελματικών εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και για οικιακά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης που καθορίζονται στο πρότυπο IEC60601-1-2.

Ο πελάτης ή ο χρήστης της RadiForce RX670 οφείλει να διασφαλίσει ότι το εν λόγω προϊόν χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας	Επίπεδο δοκιμών (T)	Επίπεδο συμμόρφωσης (C)	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) IEC61000-4-2	Εκφόρτιση επαφής ± 8 kV Εκφόρτιση αέρα ± 15 kV	Εκφόρτιση επαφής ± 8 kV Εκφόρτιση αέρα ± 15 kV	Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, μπετόν ή κεραμικά πλακίδια. Αν τα δάπεδα είναι καλυμμένα με συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 %.
Ηλεκτρικά ταχεία μεταβάσματα/Ριπές IEC61000-4-4	Γραμμές τροφοδοσίας ± 2 kV Γραμμές εισόδου/εξόδου ± 1 kV	Γραμμές τροφοδοσίας ± 2 kV Γραμμές εισόδου/εξόδου ± 1 kV	Η ποιότητα της τάσης του δικτύου κεντρικής τροφοδοσίας πρέπει να είναι ίδια με την τάση ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Υπερτάσεις IEC61000-4-5	Από γραμμή προς γραμμή ± 1 kV Από γραμμή προς γείωση ± 2 kV	Από γραμμή προς γραμμή ± 1 kV Από γραμμή προς γείωση ± 2 kV	Η ποιότητα της τάσης του δικτύου κεντρικής τροφοδοσίας πρέπει να είναι ίδια με την τάση ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Βυθίσματα τάσης, σύντομες διακοπές και διακυμάνσεις τάσης στις γραμμές εισόδου τροφοδοσίας IEC61000-4-11	0 % U_T (100 % βύθιση σε U_T) 0,5 κύκλους και 1 κύκλο 70 % U_T (30 % βύθιση σε U_T) 25 κύκλους / 50 Hz 0 % U_T (100 % βύθιση σε U_T) 250 κύκλους / 50 Hz	0 % U_T (100 % βύθιση σε U_T) 0,5 κύκλους και 1 κύκλο 70 % U_T (30 % βύθιση σε U_T) 25 κύκλους / 50 Hz 0 % U_T (100 % βύθιση σε U_T) 250 κύκλους / 50 Hz	Η ποιότητα της τάσης του δικτύου κεντρικής τροφοδοσίας πρέπει να είναι ίδια με την τάση ενός τυπικού εμπορικού ή νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Αν για τις ανάγκες του χρήστη της RadiForce RX670 απαιτείται να συνεχίζεται η λειτουργία της στη διάρκεια διακοπών ρεύματος, συνιστάται η τροφοδότηση της RadiForce RX670 από σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας ή μπαταρία.
Μαγνητικά πεδία συχνοτήτων ισχύος IEC61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Τα μαγνητικά πεδία συχνοτήτων ισχύος πρέπει να εμπίπτουν στα χαρακτηριστικά επίπεδα που ισχύουν για μια τυπική τοποθεσία σε τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. Το προϊόν πρέπει να απέχει κατά τη χρήση του τουλάχιστον 15 εκατοστά από την πηγή των μαγνητικών πεδίων συχνοτήτων ισχύος.

Δοκιμή ατρωσίας	Επίπεδο δοκιμών (T)	Επίπεδο συμμόρφωσης (C)	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγίες
Διαταραχές μετρούμενες δι' αγωγής και οφειλόμενες σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz–80 MHz 6 Vrms Ζώνες ISM ^{*1} και ερασιτεχνικές ραδιοφωνικές ζώνες ^{*2} μεταξύ 150 kHz και 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Η απόσταση του φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων από κάθε εξάρτημα του RadiForce RX670, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, πρέπει να είναι τουλάχιστον η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού που υπολογίζεται με χρήση της κατάλληλης εξίσωσης ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού. Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$
Πεδία ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz–2,7 GHz	10 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}$, 80 MHz–800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$, 800 MHz–2,7 GHz Όπου «P» είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε βατ (W) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του πομπού και «d» είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m). Οι τιμές για την ένταση πεδίου από σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως καθορίζονται από έρευνα του χώρου όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ^{*3} , πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων ^{*4} . Ενδέχεται να προκύψει παρεμβολή κοντά σε εξοπλισμό που φέρει το ακόλουθο σύμβολο. 

Σημείωση

- U_T είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) του ηλεκτρικού δικτύου πριν από την εφαρμογή του επιπέδου της δοκιμής.
- Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
- Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες για διαταραχές μετρούμενες δι' αγωγής και οφειλόμενες σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων ή σε πεδία ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από κτίρια, αντικείμενα και άτομα.

- *1 Οι ζώνες ISM (βιομηχανικών, επιστημονικών και ιατρικών εφαρμογών) μεταξύ 150 kHz και 80 MHz είναι 6,765 MHz έως 6,795 MHz, 13,553 MHz έως 13,567 MHz, 26,957 MHz έως 27,283 MHz, και 40,66 MHz έως 40,70 MHz.
- *2 Οι ζώνες ερασιτεχνικών ραδιοεκπομπών μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz είναι 1,8 MHz έως 2,0 MHz, 3,5 MHz έως 4,0 MHz, 5,3 MHz έως 5,4 MHz, 7 MHz έως 7,3 MHz, 10,1 MHz έως 10,15 MHz, 14 MHz έως 14,2 MHz, 18,07 MHz έως 18,17 MHz, 21,0 MHz έως 21,4 MHz, 24,89 MHz έως 24,99 MHz, 28,0 MHz έως 29,7 MHz, και 50,0 MHz έως 54,0 MHz.
- *3 Οι τιμές για την ένταση πεδίου από σταθερούς πομπούς, π.χ. σταθμούς βάσης για τηλέφωνα ραδιοεπικοινωνίας (κινητά/ασύρματα) και επίγειες φορητές συσκευές, ερασιτεχνικές ραδιοεκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές στα AM και στα FM και τηλεοπτικές εκπομπές, δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος που οφείλεται σε σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας έρευνας του χώρου όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Αν η μετρημένη ένταση πεδίου στον χώρο όπου χρησιμοποιείται η RadiForce RX670 υπερβαίνει το προαναφερόμενο ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης για τις ραδιοσυχνότητες, πρέπει να παρακολουθήσετε την RadiForce RX670 για να εξακριβώσετε αν λειτουργεί κανονικά. Αν παρατηρήσετε ότι οι επιδόσεις δεν είναι οι φυσιολογικές, ίσως χρειαστεί να πάρετε πρόσθετα μέτρα, π.χ. να αλλάξετε τον προσανατολισμό της RadiForce RX670 ή να τη μετακινήσετε.
- *4 Πάνω από το εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές για την ένταση πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m.

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού ή κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων και της RadiForce RX670

Η RadiForce RX670 προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον με ελεγχόμενες διαταραχές ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης ή ο πελάτης της RadiForce RX670 μπορεί να καταστείλει τη δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση (30 εκατοστά) μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (πομπών) και της RadiForce RX670. Η RadiForce RX670 έχει υποβληθεί σε δοκιμές ως προς τα παρακάτω επίπεδα συμμόρφωσης (C) για τα απαιτούμενα επίπεδα δοκιμών (T) σχετικά με την ατρωσία έναντι ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εγγύτητας στις ακόλουθες υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω ραδιοσυχνοτήτων.

Συχνότητα δοκιμής (MHz)	Εύρος ζώνης ^{*1} (MHz)	Υπηρεσία ^{*1}	Διαμόρφωση ^{*2}	Επίπεδο δοκιμών (T) ^{*3} (V/m)	Επίπεδο συμμόρφωσης (C) (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Διαμόρφωση παλμών ^{*2} 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM απόκλιση ± 5 kHz ημιτονικό 1 kHz	28	28
710	704 – 787	LTE ζώνης 13, 17	Διαμόρφωση παλμών ^{*2} 217 Hz	9	9
745					
780					
810	800 – 960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE ζώνης 5	Διαμόρφωση παλμών ^{*2} 18 Hz	28	28
870					
930					
1720	1700 – 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE ζώνης 1, 3, 4, 25, UMTS	Διαμόρφωση παλμών ^{*2} 217 Hz	28	28
1845					
1970					
2450	2400 – 2570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE ζώνης 7	Διαμόρφωση παλμών ^{*2} 217 Hz	28	28
5240	5100 – 5800	WLAN 802.11 a/n	Διαμόρφωση παλμών ^{*2} 217 Hz	9	9
5500					
5785					

^{*1} Για ορισμένες υπηρεσίες περιλαμβάνονται μόνο οι συχνότητες ανερχόμενης ζεύξης.

^{*2} Η διαμόρφωση του φορέα γίνεται με χρήση σήματος τετραγωνικού παλμού παράγοντα δράσης 50 %.

^{*3} Τα επίπεδα δοκιμών υπολογίστηκαν με τη μέγιστη ισχύ και απόσταση διαχωρισμού 30 εκ.

Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του RadiForce RX670 μπορεί να καταστείλει τις παρεμβολές από κοντινά μαγνητικά πεδία διατηρώντας την ελάχιστη απόσταση (15 εκ.) ανάμεσα στον πομπό ραδιοσυχνοτήτων και το RadiForce RX670. Το RadiForce RX670 έχει δοκιμαστεί για τα ακόλουθα επίπεδα συμμόρφωσης (Σ) για τα απαιτούμενα δοκιμαστικά επίπεδα (Δ) ατρωσίας από κοντινά μαγνητικά πεδία.

Συχνότητα δοκιμής	Διαμόρφωση	Επίπεδο δοκιμής (Δ) (A/m)	Επίπεδο συμμόρφωσης (Σ) (A/m)
30 kHz	CW (Συνεχές κύμα)	8	8
134,2 kHz	Διαμόρφωση παλμών* ¹ 2,1 kHz	65	65
13,56 MHz	Διαμόρφωση παλμών* ¹ 50 kHz	7,5	7,5

*¹ Η διαμόρφωση του φορέα γίνεται με χρήση σήματος τετραγωνικού παλμού παράγοντα δράσης 50 %.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ άλλων φορητών και κινητών εξοπλισμών επικοινωνιών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (πομπών) και των προϊόντων της RadiForce RX670 πρέπει να είναι αυτή που συνιστάται παρακάτω, με βάση τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού (W)	Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού (m)		
	150 kHz – 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz – 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz – 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού «d» σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με χρήση της κατάλληλης εξίσωσης ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού, όπου «P» είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε βατ (W) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κάθε πομπού.

Σημείωση
- Στα 80 MHz και στα 800 MHz πρέπει να ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. - Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες για διαταραχές μετρούμενες δι' αγωγής και οφειλόμενες σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων ή σε πεδία ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από κτήρια, αντικείμενα και άτομα.



EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited 
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N440AZ
IFU-RX670